

Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

N. 102 DEL 9 FEB. 2017

Oggetto: indizione di una procedura aperta per la fornitura di arredo tecnico, arredo sanitario, arredo degenza, carrelli e barelle per le varie UU.OO di questa Azienda.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica, del Dirigente della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti e del Dirigente della UOC Controllo di gestione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle motivazioni esplicitate nel documento istruttorio ed autorizzare ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di una procedura aperta per la fornitura – suddivisa in lotti - di arredi sanitari vari e relativi servizi accessori (inclusa la posa in opera a regola d'arte), per un importo massimo stimato di € 793.000,00 Iva esclusa pari ad € 967.460,00 Iva al 22% inclusa, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato (all. n1);
2. di approvare lo schema di bando integrale di gara (all.2), lo schema di disciplinare di gara e relativi allegati (all.3) il capitolato speciale (all.4), il capitolato tecnico e relativi allegati (all.5), lo schema di estratto di bando (all.6), lo schema di contratto (all.7), il DUVRI (all.8), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e degli esiti ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per una spesa complessiva presunta di € 6.000,00 IVA inclusa;
4. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il verificatore di conformità verranno nominati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;


Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017		2

5. di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, della DGRM n. 1220/2012 e all'art. 1 comma 510 della Legge n. 208/2015 (stabilità) che gli arredi previsti dalla Convenzione attivata da Consip S.p.A. in data 15/10/2014 e denominata "Arredi per Ufficio 6" non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
6. di dare atto che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà accantonata, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art.17 della L.R. 26/96;
8. di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n.412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.


Dott.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

*Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci*



*Il Direttore Sanitario
Dott. Edoardo Berselli*




Numero	1091	Pag.	
Data	- 9 FEB. 2017		3

U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si attesta di aver preso nota della spesa per le pubblicazioni del bando di gara e dei relativi esiti di gara per un importo complessivo di € 6.000,00 IVA inclusa sul conto n° 0521030201 del Bilancio Preventivo 2017 nella sub-autorizzazione EC.2017.1.1.

Il Dirigente

Dott. Massimo Del Greco


U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina, pari a complessivi € 569.740,000 IVA inclusa è stata annotata nell'autorizzazione. EC. 2017.22.0 suddivisa come segue:


- quanto ad € 555.100,00 IVA inclusa nel conto n. 01.02.02.05.01 "mobili e arredi" e trova copertura finanziaria con quota parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con DGRM n. 1640 del 27/12/2016;
- quanto ad € 14.640,00 IVA inclusa nel conto n. 01.02.02.07.07 "altri beni sanitari" e trova copertura finanziaria con quota parte dei fondi in gestione corrente assegnati dalla Regione Marche con DGRM n. 1640 del 2/12/2016.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti ed agli esercizi di competenza.


 Giampaolo B.


Il Direttore

Dott.ssa Anna Gattini


U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

Relativamente alle spese per le pubblicazioni del bando di gara e dei relativi esiti di gara si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo rispetto al budget provvisorio anno 2017 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1640 del 27/12/2016.

Il Direttore

Dott.ssa Silvia Anselmi


Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017		4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa nazionale di riferimento:

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante ad oggetto: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*. (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

D.P.R. n. 207/2010 recante ad oggetto: *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* (se ed in quanto applicabile);

Legge n. 135 del 07/08/2012 recante ad oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;

D.G.R.M. n. 1220 dell’01/08/2012 recante ad oggetto: *“Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. n.15 commi nn. 12 e 13”*.

Si richiama il seguente atto di nomina:

- nota id. n. 322487/Prov del 07/02/2017 con la quale il Dirigente della UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica ha nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, la Dott.ssa Francesca Stefanini quale Responsabile Unico del procedimento relativo all’acquisizione degli arredi ad uso sanitario oggetto del presente provvedimento di autorizzazione a contrarre.

Si richiama la seguente determinazione:

- **determina n. 1032 del 30/12/2016** recante ad oggetto: *“Programma biennale (2017-2018) degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Approvazione”*.

Premesso che con la citata determinazioni questa Azienda ha adottato un programma biennale degli acquisti di beni e servizi da effettuarsi negli anni 2017 e 2018, fra questi rientra, altresì, l’acquisizione di arredi per le varie UU.OO di questa Azienda.

In esecuzione a tali provvedimento il Dirigente di questa UOC – Settore Appalti e Contratti, ha provveduto alla pubblicazione di un avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul proprio profilo di committente, rendendo nota l’intenzione di questa Azienda di procedere alle acquisizioni ivi indicate;

Con nota id. n. 3222415/DMP del 07/02/2017 la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Pesaro ha trasmesso a questa UOC Gestione approvvigionamento di beni, servizi e logistica la relazione tecnico estimativa e relativo capitolato tecnico per l’acquisizione di arredi occorrenti a varie UU.OO.CC. aziendali.

In particolare gli arredi di che trattasi sono destinati ai seguenti Servizi aziendali Anatomia Patologica;

- Anatomia Patologica del P.O. di Pesaro;
- Chirurgia del P.O. di Pesaro;
- Neurologia del P.O. di Pesaro;
- Ortopedia del P.O. di Pesaro;
- Poliambulatori del P.O. di Pesaro;

Numero	102	Pag.	
Data	- 9 FEB. 2017,		5

- Servizi vari.

Dalla suddetta relazione (che si intende qui richiamata integralmente) emerge in particolare quanto segue:

“Analisi delle esigenze e sintesi della proposta progettuale:

a seguito della ristrutturazione della palazzina I del PO di Pesaro, delle modifiche degli spazi e dei percorsi operativi e stante l'obsolescenza di gran parte degli arredi esistenti, si rende necessario dotare i nuovi Servizi ed i locali accessori di nuovi arredi adeguati ai locali ristrutturati e alle mutate esigenze in termini di attività e organizzazione.

Tali arredi sono direttamente ed immediatamente indispensabili al perseguimento dei L.E.A.

La progettazione tecnico-estimativa è stata effettuata tenendo conto della necessità di garantire una più ampia partecipazione e non discriminazione degli aspiranti partecipanti. La fornitura è suddivisa in lotti e tale suddivisione riguarda la tipologia di beni da acquisire e non le sedi di destinazione degli stessi.

In considerazione di quanto previsto dal comma 510 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (stabilità) in merito all'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999, si evidenzia che gli arredi previsti dalla Convenzione attivata Consip in data 15/10/2014 e denominata “Arredi per Ufficio 6” non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno di cui al capitolato tecnico allegato per mancanza di caratteristiche essenziali; gli arredi oggetto della presente relazione sono infatti destinati ad ambienti ad uso sanitario/ospedaliero che pertanto richiedono adeguate ed imprescindibili caratteristiche igienico/sanitarie non previste nella citata convenzione.

In considerazione di quanto sopra esposto e considerato che gli stessi sono funzionali al regolare svolgimento delle attività sanitarie i succitati arredi sono stati inseriti nel lotto dell'arredo sanitario (cfr. in molti casi nello stesso locale dovranno coesistere arredi c.d. d'ufficio ed arredi sanitari).

Inoltre la convenzione prevede condizioni di fornitura vincolanti che non soddisfano le esigenze di questa Azienda (es. le postazioni di lavoro non possono essere separate; il rivestimento delle sedute operative non è sanificabile)

Quadro economico di progetto:

la progettazione estimativa è stata effettuata tenendo conto dei costi storici sostenuti da questa Azienda per l'acquisizione di tipologie analoghe di arredo.

Il quadro economico risulta essere pari a complessivi € 467.000,00 Iva esclusa.

La fornitura è da intendersi inclusiva della installazione degli arredi nonché dell'assistenza tecnica di tipo full-risk fissato per 36 mesi.

Criterio di aggiudicazione:

- *in relazione alle caratteristiche dei beni da acquisire e in considerazione della destinazione d'uso degli stessi si ritiene di suddividere la fornitura in relazione alla omogeneità della funzione dei prodotti e di prevedere aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo”.*

Per tutto quanto sopra esposto la UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica, sulla scorta di quanto esplicitato nella relazione tecnico estimativa e nel relativo capitolato tecnico, ha provveduto a predisporre la documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale, schema di contratto).

Si evidenzia che, stante l'importo complessivo a base d'asta della fornitura in oggetto (sopra soglia comunitaria) e tenuto conto dei tempi tecnici di espletamento delle procedure di scelta del contraente e dei relativi costi diretti ed indiretti, il RUP, d'intesa con la Direzione Generale, ha ritenuto opportuno inserire nella documentazione di gara la facoltà, per questa Azienda, di procedere all'acquisizione di ulteriori quantitativi di arredi identici a quelle aggiudicati fino alla concorrenza dell'importo massimo dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.

Nel rispetto del principio di trasparenza tale opzione di acquisto, espressamente disciplinata dall'art. 1331 del codice civile, è subordinata:

- all'emergere di ulteriori necessità;

Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017	6	

- al reperimento di idonee risorse economiche;
- ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva;
- verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

Resta inteso che qualora l'Azienda non eserciti tale opzione l'impresa aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa e/o indennizzo. Inoltre, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tale opzione concorre alla determinazione dell'importo massimo stimato di ogni singolo lotto.

Per chiarezza espositiva si formulano le seguenti precisazioni:

- trattandosi di fornitura per un importo complessivo massimo (inclusa la ridetta opzione d'acquisto) pari ad € 793.000,00 Iva esclusa e tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, si ritiene di avviare, per l'affidamento della fornitura in parola, una procedura aperta a livello europeo alle condizioni fissate nella documentazione di gara allegata al presente provvedimento (all. n.1- 8);
- in conformità a quanto analiticamente indicato nel capitolato tecnico, l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, per singolo lotto intero non frazionabile in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- gli arredi di che trattasi sono direttamente e immediatamente indispensabili al perseguimento dei LEA (come attestato dal progettista); pertanto all'acquisto oggetto del presente provvedimento non è applicabile la limitazione di cui all'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012 come precisato dal Collegio Sindacale nel verbale n. 72 del 16/04/2015;
- ad oggi risulta attiva una Convenzioni denominata "Arredi per Ufficio 6" attivata da Consip S.p.A. in data 15/10/2014 avente ad oggetto arredi le cui caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno di cui al capitolato tecnico allegato per mancanza di caratteristiche essenziali e adeguate all'uso in ambiente sanitario/ospedaliero come meglio precisato nella citata relazione tecnico-estimativa redatta dal progettista; a tal proposito si precisa che il RUP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 510 della Legge n. 208/2015, procederà a trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione della Cort dei Conti;
- i prodotti di cui al presente provvedimento non rientrano fra le categorie merceologiche per le quali il soggetto aggregatore/SUAM ha l'obbligo di avviare procedure di acquisto nel corso dell'anno 2017. A tale riguardo si richiama la clausola di salvaguardia inserita nel capitolato speciale che:
 - a) prevede la facoltà dell'Azienda Marche Nord di non procedere alla sottoscrizione del contratto con la/e società aggiudicataria/e qualora, nelle more della medesima sottoscrizione, venga avviata una convenzione Consip o aggiudicata dal soggetto aggregatore una fornitura avente ad oggetto beni che soddisfino le esigenze di questa Azienda;
 - b) subordina l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto di ulteriori quantitativi di arredi alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente ad oggetto beni che soddisfino le esigenze di questa Azienda.


Infine si precisa che:

- ❖ con nota prot. n. 5312/AA.GG. del 07/02/2017 il Direttore Amministrativo ha disposto di procedere alla realizzazione dell'investimento di chi trattasi;
- ❖ nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene, d'intesa con la Direzione Generale, di procedere all'accantonamento della somma corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base d'asta.

Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017		7


Per quanto sopra esposto di propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1) di predere atto delle motivazioni esplicitate nel documento istruttorio ed autorizzare ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di una procedura aperta per la fornitura – suddivisa in lotti - di arredi sanitari vari e relativi servizi accessori (inclusa la posa in opera a regola d'arte), per un importo massimo stimato di € 793.000,00 Iva esclusa pari ad € 967.460,00 Iva al 22% inclusa, come dettagliatamente indicato nel prospetto allegato (all. n1);
- 2) di approvare lo schema di bando integrale di gara (all.2), lo schema di disciplinare di gara e relativi allegati (all.3) il capitolato speciale (all.4), il capitolato tecnico e relativi allegati (all.5), lo schema di estratto di bando (all.6), lo schema di contratto (all.7), il DUVRI (all.8), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara e degli esiti ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per una spesa complessiva presunta di € 6.000,00 IVA inclusa;
- 4) di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il verificatore di conformità verranno nominati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 5) di attestare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, della DGRM n. 1220/2012 e all'art. 1 comma 510 della Legge n. 208/2015 (stabilità) che gli arredi previsti dalla Convenzione attivata da Consip S.p.A. in data 15/10/2014 e denominata "Arredi per Ufficio 6" non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
- 6) di dare atto che nel provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà accantonata, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio


Il Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Francesca Stefanini



Numero	102	Pag.	
Data	9 FEB. 2017		8

- ALLEGATI -

N.8 allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti.

AII. 1 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER DETERMINA

DESCRIZIONE	LOTTO 1 ARREDO TECNICO	LOTTO 2 ARREDO SANITARIO	LOTTO 3 ARREDO DEGENZA	LOTTO 4 CARRELLI	LOTTO 5 BARELLE	Importo compl.vo IVA ESCLUSA
IMPORTO A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	€ 110.000,00	€ 175.000,00	€ 145.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 467.000,00
IMPORTO A BASE 'ASTA IVA INCLUSA	€ 134.200,00	€ 213.500,00	€ 176.900,00	€ 30.500,00	€ 14.640,00	€ 569.740,00
OPZIONE D'ACQUISTO IVA ESCLUSA	€ 88.000,00	€ 100.000,00	€ 116.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 326.000,00
OPZIONE D'ACQUISTO IVA INCLUSA	€ 107.360,00	€ 122.000,00	€ 141.520,00	€ 12.200,00	€ 14.640,00	€ 397.720,00
IMPORTO COMPL.VO DEL LOTTO INCLUSA OPZIONE D'ACQUISTO IVA ESCLUSA	€ 198.000,00	€ 275.000,00	€ 261.000,00	€ 35.000,00	€ 24.000,00	€ 793.000,00
IMPORTO COMPL.VO DEL LOTTO INCLUSA OPZIONE D'ACQUISTO IVA INCLUSA	€ 241.560,00	€ 335.500,00	€ 318.420,00	€ 42.700,00	€ 29.280,00	€ 967.460,00

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

Schema di Bando di gara - Forniture.

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Francesca Stefanini, tel. 0721/366343, francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336.; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; **I.3)** Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dalla UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord" V.le Trieste, 391 - 61121 Pesaro - Italia. Persona di contatto: dott.ssa Francesca Stefanini tel. 0721/366343 email: francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITE31. Indirizzi Internet: www.ospedalimarchenord.it. **I.4)** Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. **I.5)** Principali settori di attività: Salute; **SEZIONE II: Oggetto dell'appalto; II.1.1)** Denominazione conferita all'appalto: procedura aperta per la fornitura in lotti distinti di arredi per varie UU.OO. di questa Azienda; **II.1.2)** Codice CPV principale: 39290000-1; **II.1.3)** Tipo di appalto: forniture; **II.1.4)** Breve descrizione: fornitura, in lotti distinti, di arredi per le varie UU.OO.; **II.1.5)** Valore totale stimato: € 793.000,00 Iva esclusa; **II.1.6)** Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 5; **II.2.1) Denominazione: fornitura di arredo tecnico; lotto n.1; II.2.2)** Codici CPV supplementari: 39290000-1; **II.2.3)** Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; **II.2.4)** Descrizione dell'appalto: arredo tecnico; **II.2.5)** Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; **II.2.6)** Valore stimato: € 198.000,00 Iva esclusa; **II.2.7)** Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 24; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo; no; **II.2.10)** informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; **II.2.11)** informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi della UE: l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; **II.2.1) Denominazione: fornitura di arredo sanitario; lotto n.2; II.2.2)** Codici CPV supplementari: 39150000-8; **II.2.3)** Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; **II.2.4)** Descrizione dell'appalto: arredo sanitario; **II.2.5)** Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; **II.2.6)** Valore stimato: € 275.000,00 Iva esclusa; **II.2.7)** Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 24; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo; no; **II.2.10)** informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; **II.2.11)** informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi della UE: l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; **II.2.1) Denominazione: fornitura di arredo degenza; lotto n.3; II.2.2)** Codici CPV supplementari: 39150000-8; **II.2.3)** Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; **II.2.4)** Descrizione dell'appalto: arredo degenzai; **II.2.5)** Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; **II.2.6)** Valore stimato: € 261.000,00 Iva esclusa; **II.2.7)** Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 24; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo; no; **II.2.10)** informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; **II.2.11)** informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi della UE: l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; **II.2.1) Denominazione: fornitura di carrelli; lotto n.4; II.2.2)** Codici CPV supplementari: 34911100-7; **II.2.3)** Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; **II.2.4)** Descrizione dell'appalto: carrelli; **II.2.5)** Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; **II.2.6)** Valore stimato: € 35.000,00 Iva esclusa; **II.2.7)** Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 24; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo; no; **II.2.10)** informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; **II.2.11)** informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; **II.2.13)** Informazioni relative ai fondi della UE: l'appalto è connesso ad un

progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; **II.2.1) Denominazione: fornitura di barelle; lotto n.5; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33192160-1; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; II.2.4) Descrizione dell'appalto: barelle; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: € 24.000,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d'appalto: durata in mesi: 24; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo; no; II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; si rinvia all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; **SEZIONE IV: Procedura; IV.1.) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici: l'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: _____ ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno _____ ore 11:30 presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell'A.O. "Ospedali Riuniti Marche Nord", Viale Trieste 391 - Pesaro. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara. **SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazione relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: la fornitura è articolata in n. 5 lotti unici non frazionabili. CIG: Lotto 1 Cig: 6971235D19; Lotto 2 Cig: 697125097B; Lotto 3 Cig: 6971286731; Lotto 4 Cig: 6971293CF6; Lotto 5 Cig: 6971296F6F. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida per singolo lotto. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando all'indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. **Farà fede il timbro apposto sul plico sigillato dal protocollo della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse.********

E' vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all'indizione della procedura aperta n. _____/DG del _____ di questa Azienda.

Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta (a mezzo fax al n°0721/366336) alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni e servizi e logistica di questa Azienda entro le ore 11:00 giorno _____. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno _____ mediante pubblicazione sul sito www.ospedalimarchenord.it. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Questa Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Stefanini. **VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: _____ Pesaro, _____ 6.**

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Stefanini.

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA
Viale Trieste, 391 – 61121 Pesaro (PU) Tel. 0721-366343/40/41 – Fax 0721-366336.

SCHEMA

AII. 3 - DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI ARREDI VARI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI (INCLUSA LA POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE) PER VARIE UU.OO. DI QUESTA AZIENDA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la fornitura – suddivisa in lotti - inclusa l'installazione e a posa in opera e regola d'arte - occorrenti alle varie UU.OO. di questa Azienda, come meglio specificato nella documentazione di gara allegata.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. _____ del _____ e avverrà mediante procedura aperta e con il ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice).

Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data _____.

La documentazione di gara comprende:

1. BANDO INTEGRALE DI GARA;
2. DISCIPLINARE DI GARA e relativi allegati:
 - B.1) Documento di gara unico europeo (DGUE);
 - B.2) domanda di partecipazione e modulo dichiarazione di atto notorio;
 - B.3) modulo offerta;
3. CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
4. CAPITOLATO TECNICO e relativi allegati (planimetrie);
5. SCHEMA DI CONTRATTO;
6. DOCUMENTO INFORMATIVO AORMN destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008;
7. D.U.V.R.I;
8. PATTO DI INTEGRITA' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Francesca Stefanini mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto ed il verificatore di conformità verranno nominati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni/servizi:

- fornitura, trasporto e consegna nei luoghi di installazione di arredi e complementi di arredo;
- installazione e posa in opera a regola d'arte;
- servizi di assistenza post-vendita e post-garanzia;

1.2 la fornitura dovrà essere effettuata entro i termini di esecuzione previsti dal capitolato speciale e dal capitolato tecnico e nel rispetto delle modalità dettagliatamente descritti nei suddetti documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 793.000,00 Iva esclusa così suddiviso:

Tabella 1)

LOTTE	IMPORTO A BASE D'ASTA DEL LOTTO IVA ESCLUSA (col. A)	Opzione d'acquisto IVA esclusa (col. B)	IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL LOTTO, IVA ESCLUSA (somma col. A + col. B)	CIG
1 ARREDO TECNICO	€ 110.000,00	€ 88.000,00	€ 198.000,00	6971253D19
2 ARREDO SANITARIO	€ 175.000,00	€ 100.000,00	€ 275.000,00	697125097B
3 ARREDO DEGENZA	€ 145.000,00	€ 116.000,00	€ 261.000,00	6971286731
4 CARRELLI	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00	6971293CF6
5 BARELLE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	6971296F6F

Offerte di importo superiore all'importo complessivo a base d'asta (col. A) verranno escluse. Le modalità ed i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione sono disciplinati dall'art. 2 del capitolato speciale.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3

3. REQUISITI

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

3.2 Per la partecipazione alla presente procedura gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- **requisiti di idoneità professionale (cfr. art. art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016):** iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. In caso di operatore economico di altro Stato membro si rinvia a quanto previsto dal citato comma 3 dell'art. 83 del Codice;

3.3 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso del requisito di idoneità professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Si rinvia integralmente a quanto disposto dal citato art. 89 del Codice.

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Questa Azienda si riserva comunque di attivare anche le verifiche direttamente dalle PP.AA. certificanti

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

5.1. La documentazione elencata in premessa è disponibile sia sul sito internet aziendale: <http://www.ospedalimarchenord.it>;

5.2. E' facoltà delle imprese partecipanti prendere visione delle sedi e dei locali interessati alla fornitura oggetto del presente appalto;

5.3. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno effettuare esplicita richiesta da inviare alla UOC, mediante mail ai seguenti indirizzi:

- francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it;
- chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it.

La richiesta dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12:00 del _____.

La richiesta di sopralluogo dovrà indicare la ragione sociale dell'operatore economico richiedente, il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/fax cui indirizzare la convocazione. Eventuali richieste di sopralluogo pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

5.4. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 3 (tre) giorni di anticipo. Il sopralluogo verrà effettuato presumibilmente entro il _____.

6. CHIARIMENTI

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: aomarchenord@emarche.it e via mail al seguente indirizzo: _____, entro e non oltre il _____. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il _____ mediante pubblicazione di un documento denominato "Chiarimenti del _____", sul sito internet: <http://www.ospedaliriunitimarchenord.it>.

6.3. Questa Azienda si riserva di pubblicare nel citato sito eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

6.4. Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati tutti i chiarimenti pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara e tutte le integrazioni/modifiche/rettifiche apportate dalla Stazione Appaltante alla documentazione di gara pubblicati sul sito internet aziendale entro il termine ultimo indicato nel bando di gara.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

7.1 La domanda di partecipazione e le restanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e della restanti dichiarazioni richieste gli operatori economici potranno utilizzare apposito modulo allegato al presente (all. n2)

7.2. Le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. punto 3 del presente disciplinare) devono essere rese mediante compilazione del modello DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs.50/2016 compilato secondo le modalità indicate nel Regolamento UE del 05/01/2016 (scaricabile dal sito internet aziendale);

7.3 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/00;

7.4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

7.5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana con allegata dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, di conformità all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

8. COMUNICAZIONI

8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e/o al numero di fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76 del Codice in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO

a. Il concorrente deve indicare nel DGUE (cfr. parte II "Informazioni sull'operatore economico" lett. D) le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

b. Ai sensi del comma 7 del citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 al momento del deposito del contratto di subappalto presso questa Azienda l'aggiudicatario dovrà fornire la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

10.1. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

10.2. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito internet aziendale;

10.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

10.4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. E' fatta salva la facoltà di sottoscrivere i contratti sotto condizione risolutiva dell'esito positivo della verifica dei requisiti;

10.5. Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso d'esito sulla Gazzetta Ufficiale italiana e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Per una maggiore trasparenza questa Azienda comunicherà, unitamente ai chiarimenti richiesti di cui al punto 6 del presente disciplinare, l'importo sostenuto per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara;

11. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da **garanzia provvisoria**, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 93 del Codice, pari al 2% **dell'importo a base d'asta** (cfr. punto 1), tabella 1, col. A del presente disciplinare).

11.2. Nell'ipotesi in cui la garanzia provvisoria venga presentata in contanti si forniscono i seguenti dati:
a) versamento presso Banca della Marche c.corrente di tesoreria n. 2100400 intestato ad Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" – IBAN: IT57 X 06055 13310 000000028325;

Il concorrente che intenda partecipare a più di un lotto può presentare un'unica cauzione provvisoria purché la stessa indichi i lotti per i quali viene presentata offerta.

11.3. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** nel rispetto e con le modalità di cui al citato art. 93, comma 8 del Codice.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità scegliendo tra le modalità previste dall'ANAC (ex AVCP) per i seguenti importi:

- € 20,00 per la partecipazione al Lotto n. 1;
- € 20,00 per la partecipazione al Lotto n. 2;
- € 20,00 per la partecipazione al Lotto n. 3.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta deve essere, **a pena di esclusione**, sigillato e deve pervenire, entro le **ore 11.00 del giorno** _____, esclusivamente all'indirizzo di seguito indicato: U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", Ufficio Protocollo - V.le Trieste, 391 (secondo piano), 61121 Pesaro (orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30).

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 tutti i giorni (escluso il sabato) presso l'ufficio protocollo della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica sito in V.le Trieste, 391 Pesaro (secondo piano).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura **"Procedura aperta per la fornitura di arredi vari - lotti _____**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 1) "A - Documentazione amministrativa"; 2) "B - Offerta tecnica"; 3) "C - Offerta economica".

13.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

13.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara, non verranno prese in considerazione le offerte in alternativa

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti in copia cartacea e su supporto informatico (CD/DVD):

14.1. **domanda di partecipazione**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

14.2. **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- attesta di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura;

inoltre il concorrente è tenuto a *(tali dichiarazioni non sono da ritenersi essenziali)*:

- autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure)
non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 14.1 e 14.2 il concorrente/i ha facoltà di utilizzare il modulo predisposto da questa Azienda e messo a disposizione

sul sito aziendale (cfr. modulo domanda di partecipazione e modulo dichiarazione di atto notorio – all. B.2 al presente disciplinare);

14.3. **DGUE** debitamente compilato e sottoscritto con le modalità di cui al regolamento UE 2016/7 del 05/01/2016. Le sezioni del DGUE che devono essere compilate sono le seguenti: _____;

14.4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

14.5. a pena di esclusione, documento attestante la **cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11;

14.6 a pena di esclusione, **impegno del fideiussore**;

14.7. **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI: si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

14.8. Nelle ipotesi di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo trova applicazione Part. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La sanzione pecuniaria prevista è fissata nella misura pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo posto a base d'asta.

14.9 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, questa Azienda ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al citato Part. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, senza applicare alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione l'operatore economico verrà escluso dalla procedura.

15. DOCUMENTAZIONE TECNICA

15.1. Le imprese concorrenti sono tenute a presentare la seguente documentazione tecnica:

✓ **relazione tecnica** articolata come segue:

- a) attestazione che tutti i prodotti offerti possiedono le caratteristiche tecniche minime o EQUIVALENTI (con specifica giustificazione di semplice lettura e immediato confronto dell'equivalenza) - richieste a pena di esclusione dal capitolato tecnico;
- b) trattazione degli elementi di valutazione tecnica di seguito indicati:
 - proposte innovative/migliorative (progetto di ottimizzazione per lo sfruttamento dei volumi e degli spazi; qualità e spessore dei materiali offerti);
 - caratteristiche costruttive/struttura dei prodotti offerti;
 - modularità/interscambiabilità;
 - qualità delle componenti accessorie;
 - ergonomia;
 - facilità di pulizia e disinfezione;
 - eventuale estensione del periodo di garanzia;
 - servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza.

Alla relazione tecnica dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnica – per singola tipologia di prodotto offerto - dalla quale si evinca quanto dichiarato nella stessa (relativamente sia la punto a) che al punto b).

La relazione deve consistere in massimo di 10 facciate di pagina, formato A4, formato word, carattere Times New Roman dimensione 12.

✓ **dichiarazione** relativa alle certificazioni tecniche dei prodotti con elenco analitico delle norme di riferimento;

✓ **eventuale prova di equivalenza**, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016;

✓ **prospetto** della composizione d'arredo offerta per ciascuno dei locali e delle aree da attrezzare;

✓ **scheda pantone** con tutte le alternative di colore per le superfici ed i tessuti;

✓ **altra documentazione tecnica** aggiuntiva (eventuale);

✓ **piano dei tempi** per consegna e installazione;

La documentazione tecnica dovrà essere strettamente correlata ai requisiti richiesti, strettamente attinente alla relazione tecnica, non sovrabbondante o ripetitiva.

La documentazione tecnica dovrà essere fornita sia in formato cartaceo sottoscritto (in caso di rilegatura a caldo dei documenti componenti la documentazione tecnica, e quindi con fogli inamovibili,

è possibile sottoscrivere unicamente la prima e ultima pagina di ciascuna rilegatura) sia in formato elettronico firmata digitalmente su CD-ROM/chiavetta USB non riscrivibile in 3 copie contenenti la documentazione cartacea presentata.

La documentazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, è vietato il soccorso istruttorio della documentazione tecnica.

16 OFFERTA ECONOMICA

16.1 Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo lo schema allegato al presente disciplinare di gara (all.n.B 3).

16.2. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti.

16.3. All'interno della busta "C-offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 97 Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "giustificazioni". La mancata produzione anticipata delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione dalla gara.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

17.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a lotto intero non frazionabile, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei parametri della qualità e del prezzo **riservando alla qualità 60 punti e al prezzo 40 punti.**

Il **punteggio tecnico (PT)** viene determinato secondo le modalità dettagliatamente indicate al successivo punto 17.4 e secondo i criteri ivi indicati.

Saranno ammesse a partecipare alla fase di apertura delle buste relative alla offerta economica le sole offerte che avranno ottenuto un Punteggio Tecnico definitivo superiore o uguale a 33 punti.

Il **punteggio economico (PE)** viene determinato secondo le modalità indicate al successivo punto 17.5.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio tecnico conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica:

Punteggio Complessivo = PT+PE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Non saranno prese in esame offerte parziali e/o alternative.

Questa Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi art. 95, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

17.2. Operazioni di gara

17.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica il giorno _____ alle ore 11.30.

I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti potranno rendere dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.2.3. Il RUP o persona da questi delegata, alla presenza di due testimoni della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

17.2.4. Successivamente si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 55 del Codice. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione alle imprese partecipanti con preavviso di circa 3 (tre) giorni procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La Commissione procederà, in sedute riservate, all'esame dei contenuti dei documenti presentati ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

17.2.5. Successivamente, in seduta pubblica, e previa comunicazione alle imprese partecipanti con preavviso di circa 3 (tre) giorni la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei relativi prezzi offerti.

17.2.6. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi economici ed alla somma degli stessi con i punteggi tecnici, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara ed all'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

17.2.7. Successivamente la Commissione giudicatrice procederà alla eventuale verifica di congruità dell'offerta provvisoriamente aggiudicataria che superi la soglia di anomalia cui all'art. 97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

17.2.8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

17.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

17.2.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP predispone il provvedimento di aggiudicazione definitiva che verrà adottato dal Direttore Generale.

17.3. Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della busta "A"

17.3.1. Il RUP, in seduta pubblica (vedasi punto 17.2.1), sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede come segue:

a) verifica la correttezza e la completezza della documentazione.

Il RUP, come previsto dalla deliberazione dell'ANAC n.1 del 08/01/2015 procede all'immediata all'esclusione nelle ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; il RUP procederà altresì all'esclusione in caso di assenza dei requisiti di partecipazione richiesti;

b) verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorzio;

c) verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GHIB, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

17.3.2. I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3 del presente disciplinare potranno essere comprovati con i mezzi di prova di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016;

17.3.3. Il RUP si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione amministrativa presentata.

17.4. Valutazione dell'offerta tecnica – contenuto della busta “B”

17.4.1. La Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B-Offerta tecnica”, attribuirà, a proprio giudizio insindacabile, il PT il PT attraverso i coefficienti $Q_{(i)}$, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:

Tab. 1) Criteri per Lotto: 1 – Arredo tecnico, Lotto: 2 Arredo sanitario, Lotto 3: Arredo degenza.

N°	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Proposte innovative/migliorative:	0-28
	- Progetto di ottimizzazione sfruttamento dei volumi e degli spazi	0-16
	- qualità e spessore dei materiali offerti (anche in funzione della prevenzione delle infezioni)	0-12
2	Caratteristiche costruttive/struttura dei prodotti	0-10
3	Modularità/interscambiabilità	0-4
4	Qualità delle componenti accessorie (cerniere, guarnizioni, ruote, staffe)	0-4
5	Ergonomia	0-4
6	Facilità di pulizia e disinfezione	0-4
7	Eventuale estensione del periodo di garanzia rispetto alla durata minima prevista dal capitolato	0-4
8	Servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza (organizzazione del servizio, durata disponibilità delle parti di ricambio)	0-2
	PUNTEGGIO MASSIMO	60

Tab. 2 Criteri per Lotto 4: Carrelli, Lotto 5: Barelle.

N°	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Caratteristiche strutturali	0-30
	- caratteristiche strutturali/composizione e qualità dei materiali offerti	0-24
	- caratteristiche dei materiali in funzione della prevenzione delle infezioni	0-6
2	Caratteristiche ergonomiche e di sicurezza	0-24
	- Facilità di utilizzo, di spostamento, di manovrabilità	0-12

	- Qualità delle componenti accessorie (cerniere, guarnizioni, ruote, staffe, ecc.)	0-6
	- Facilità di pulizia e disinfezione	0-6
3	Eventuale estensione del periodo di garanzia rispetto alla durata minima prevista dal capitolato	0-4
4	Servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza (organizzazione del servizio, durata disponibilità delle parti di ricambio)	0-2
	PUNTEGGIO MASSIMO	60

A ciascun elemento di valutazione della qualità sarà attribuito un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata) che sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento di valutazione.

0	In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato
0,25	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "scarso"
0,50	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "accettabile"
0,65	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "più che accettabile"
0,75	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "buono"
0,85	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "molto buono"
1	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "ottimo"

ELEMENTI MOTIVAZIONALI:

La Commissione giudicatrice per ogni lotto dell'appalto considererà i seguenti elementi motivazionali riguardo ai coefficienti sopra indicati.

Tab. 1 Criteri per Lotto arredo tecnico, Lotto arredo sanitario, Lotto arredo degenza

Proposte innovative/migliorative: verrà assegnato il coefficiente massimo al progetto che sarà considerato più rispondente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera in termini di razionale e ottimale sfruttamento dei volumi e degli spazi nell'ottica di una piena compatibilità con i processi di lavoro; verranno premiati i materiali di qualità e con caratteristiche ottimali anche sotto il profilo della prevenzione delle infezioni.

Caratteristiche costruttive/struttura dei prodotti: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli con caratteristiche costruttive e strutturali che garantiranno maggiore rispondenza alle esigenze dell'Azienda ospedaliera in termini di vantaggi per l'utilizzo (solidità struttura, morfologia adeguata, compatibilità con le specifiche operazioni di lavoro).

Modularità/interscambiabilità: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli che dimostrano di essere facilmente utilizzabili in diverse postazioni di lavoro e catene di produzione e che consentono differenti modalità di impiego.

Qualità delle componenti accessorie (cerniere, guarnizioni, ruote, staffe, ecc.): sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli che possiedono qualità e funzionalità di impiego ottimale delle componenti accessorie.

Ergonomia: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli che possiedono condizioni di utilizzo ergonomiche facilitando l'ottimale integrazione tra lavoro e attrezzature, nonché le posture corrette in termini di sicurezza dei lavoratori e il migliore rendimento possibile dell'attività lavorativa.

Facilità di pulizia e disinfezione: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli con caratteristiche tali da facilitare in termini di tempo e modalità di esecuzione le operazioni di pulizia e di disinfezione e costituiti da materiali compatibili con i comuni disinfettanti utilizzati in ambiente ospedaliero.

Eventuale estensione del periodo di garanzia rispetto alla durata minima prevista dal capitolato: sarà assegnato coefficiente massimo alla maggiore estensione offerta del periodo di garanzia rispetto ai termini minimi di norma.

Servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza (organizzazione del servizio, durata disponibilità delle parti di ricambio, ecc.): sarà assegnato coefficiente massimo alla migliore offerta in termini di qualità del servizio di assistenza di durata della disponibilità delle parti di ricambio, ecc.

Tab. 2 Criteri per Lotto carrelli, Lotto barelle.

Caratteristiche strutturali: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli con caratteristiche costruttive e strutturali che garantiranno maggiore rispondenza alle esigenze dell'Azienda ospedaliera in termini di vantaggi per l'utilizzo (solidità struttura, morfologia adeguata, compatibilità con le specifiche operazioni di lavoro); verranno premiati i materiali di qualità e con caratteristiche ottimali anche sotto il profilo della prevenzione delle infezioni.

Caratteristiche ergonomiche e di sicurezza: sarà assegnato coefficiente massimo agli articoli che dimostrano ottimale facilità di utilizzo, di spostamento e di manovrabilità, che possiedono elementi accessori di qualità e rispondenti alle esigenze operative per il personale dell'Azienda Ospedaliera e che hanno caratteristiche tali da facilitare in termini di tempo e modalità di esecuzione le operazioni di pulizia e di disinfezione e costituiti da materiali compatibili con i comuni disinfettanti utilizzati in ambiente ospedaliero.

Eventuale estensione del periodo di garanzia rispetto alla durata minima prevista dal capitolato: sarà assegnato coefficiente massimo alla maggiore estensione offerta del periodo di garanzia rispetto ai termini minimi di norma.

Servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza (organizzazione del servizio, durata disponibilità delle parti di ricambio, ecc.): sarà assegnato coefficiente massimo alla migliore offerta in termini di qualità del servizio di assistenza di durata della disponibilità delle parti di ricambio, ecc.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo assegnato sia inferiore a 33 punti.

Dopo l'assegnazione dei punteggi tecnici, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene sugli elementi di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata - per singolo elemento di valutazione - la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Successivamente, per ogni singola offerta, si procederà ad effettuare la somma dei punteggi riparametrati attribuiti dalla commissione giudicatrice per ciascun elemento qualitativo (cd. somma provvisoria).

N°	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Proposte innovative/migliorative:	0-25
	- Progetto di ottimizzazione sfruttamento dei volumi e degli spazi	0-15
	- qualità e spessore dei materiali offerti	0-10
2	Caratteristiche costruttive/struttura dei prodotti	0-5
3	Modularità/interscambiabilità	0-5
4	Qualità delle componenti accessorie (cerniere, guarnizioni, ruote, staffe)	0-5
5	Ergonomia	0-5
6	Facilità di pulizia e disinfezione	0-5
7	Eventuale estensione del periodo di garanzia rispetto alla durata minima prevista dal capitolato	0-5
8	Servizio post-garanzia di manutenzione e assistenza (organizzazione del servizio, durata disponibilità delle parti di ricambio)	0-5
	PUNTEGGIO MASSIMO	60

A ciascun elemento di valutazione della qualità sarà attribuito un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sotto riportata) che sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento di valutazione.

0	In caso di mancanza di documentazione o di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato
0,25	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "scarso"
0,50	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "accettabile"
0,65	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "più che accettabile"
0,75	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "buono"
0,85	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "molto buono"
1	In relazione ad un giudizio espresso sul parametro considerato "ottimo"

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico complessivo assegnato sia inferiore a 33 punti.

Dopo l'assegnazione dei punteggi tecnici, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene sugli elementi di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata - per singolo elemento di valutazione - la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Successivamente, per ogni singola offerta, si procederà ad effettuare la somma dei punteggi riparametrati attribuiti dalla commissione giudicatrice per ciascun elemento qualitativo (cd. somma provvisoria).

17.5. Apertura offerte economiche – busta "C"

17.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "C-Offerta economica", dando lettura dei prezzi offerti.

17.5.2. La Commissione provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula denominata formula "non lineare con $\alpha < 1$ " di seguito riportata:

$$P_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Definizione	Significato
R_i [0;1]	Ribasso percentuale offerto dall'i-sima Ditta
R_{max}	Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
α	Coefficiente pari a 0,4

Si evidenzia che l'adozione di questa formula permette di sfruttare l'intero range di punteggio disponibile (0-40 punti) attribuendo il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto più elevato e il punteggio nullo all'offerta che non presenta sconto inoltre disincentiva il ricorso a ribassi eccessivi.

17.5.3. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione giudicatrice procede alle verifiche di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

19. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'impresa aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto, e comunque prima dell'emissione degli ordinativi di fornitura, dovrà procedere ad effettuare il sopralluogo dei locali interessati alla fornitura.

20. STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Per i tempi e per la formalizzazione del contratto si rinvia agli artt. 32 e 77 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare si procederà alla formalizzazione contrattuale mediante sottoscrizione con modalità elettronica di contratto/scrittura privata tra le parti, il cui schema fa parte della documentazione di gara. Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione contrattuale sono ad esclusivo carico, senza diritto di rivalsa, dell'impresa aggiudicataria.

La formalizzazione contrattuale svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria; non si procederà pertanto alla restituzione della medesima.

Questa Azienda si riserva:

1. la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle ipotesi di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
3. di non procedere alla sottoscrizione del contratto con la/e società aggiudicataria/e qualora, nelle more della medesima sottoscrizione, venga avviata una convenzione Consip o aggiudicata dal soggetto aggregatore una fornitura identica a quella oggetto della presente procedura avente condizioni economiche migliorative.

21. GARANZIE DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata all'impresa capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le imprese facenti parte dello stesso.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro i termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara.

Lo svincolo della cauzione definitiva anzidetta sarà disposto da questa Azienda su espressa richiesta dell'impresa aggiudicataria solo dopo l'attestazione di corretta e regolare esecuzione della fornitura.

22. ALTRE NORME

L'aggiudicazione diverrà definitiva dopo l'approvazione delle risultanze da parte di questa Azienda.

Questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Per quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara, si rinvia alla documentazione di gara elencata in premessa, al codice civile nonché alla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica, tel. 0721/366340-6341; fax: 0721/366336.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Francesca Stefanini**

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione. b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] [.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III, 1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....] [.....] [.....] [.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.)</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [.....]</p>

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Si [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un D.G.U.E. distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] Si [] No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹⁵⁾
2.	Corruzione ⁽¹⁶⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice;

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] [.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁶⁾ : a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data: [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi: [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [].

⁽¹⁵⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11.11.2008, pag. 42).

⁽¹⁶⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 182 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/829/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione:	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ : [.....] [.....] [.....]	

C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽²¹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²²⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.


<p>- ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

D. ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), j), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
<p>Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]⁽²⁶⁾</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f).</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

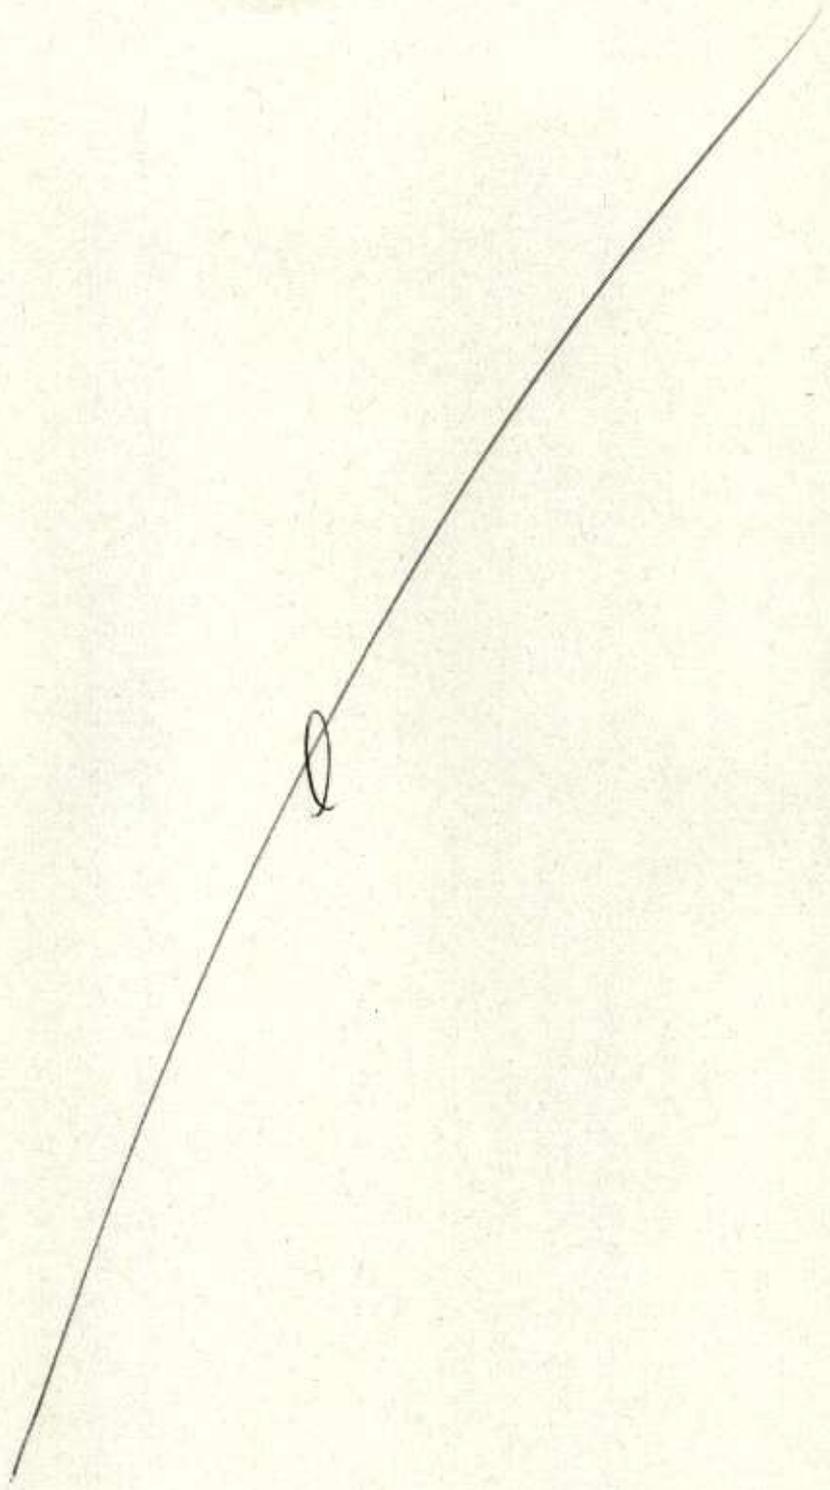

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE, gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ^(2b):</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ^(2b):</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p>	<p>[.....]</p>

^(2a) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

^(2b) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾.</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	<p>[] Sì [] No</p>								
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p>									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro;	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>	<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>	<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>
<p>Risposta:</p>	<p>Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale</p>

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

<p>Se la documentazione pertinente è eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>	<p>Se la documentazione pertinente è eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare: l'indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....] [.....]</p>
--	--

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁸⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento .	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'evoluzione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

All'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"
Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)**

Oggetto della gara: fornitura di arredi per le varie UU.OO. di questa Azienda.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ (_____) _____
residente a _____ (_____) Via _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
della ditta _____ (di seguito nominata per brevità Impresa)
con _____ sede _____ legale _____ in _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

A) DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME (barrare la casella corrispondente):

impresa singola;

B) che le comunicazioni relative alla procedura di acquisizione oggetto della presente dichiarazione e del contratto che verrà sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo pec:

_____;

C) che gli ordinativi di fornitura dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo mail:

_____;

INOLTRE:

- **dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **accetta**, a pena di esclusione, il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- **accetta**, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- **attesta** di aver perfetta conoscenza dell'ubicazione delle strutture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura e che non si rendono necessari lavori di adeguamento tecnico impiantistico nel locale di installazione;
- **dichiara di aver effettuato le seguenti forniture identiche (dettagliare sia la tecnologia che il materiale di consumo):**

data	destinatario	Codice prodotto	Importo IVA esclusa

- dichiara di accettare le clausole contenute nel documento denominato "Disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche", allegato al capitolato tecnico;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il Dichiarante 

In particolare il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art.1341 c.c., di accettare le disposizioni contenute nella documentazione di gara

Il Dichiarante 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- L'impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste e/o allegare al presente schema eventuali ulteriori dichiarazioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e smi:

Si informa che:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
- i dati possono essere comunicati a:
 1. personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento
 2. concorrenti che partecipano alla gara
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241
 4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa, in caso di mancato conferimento questa Azienda si riserva di chiedere l'integrazione della documentazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'ESCLUSIONE;
- il Responsabile del trattamento è il Dott.ssa Chiara D'Eusanio, mentre soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all'indirizzo specificato.



All. n. 4 - CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (CS) disciplina la fornitura – suddivisa in lotti - di Arredi vari e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna nelle sedi di destinazione, assemblaggio ed installazione/posa in opera a regola d'arte, per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Nel corpo del CS con il termine:

- 1) **SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- 2) **Concorrente o ditta concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del contratto in oggetto;
- 3) **Aggiudicatario o impresa aggiudicataria:** l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di imprese risultato aggiudicatario;
- 4) **CT (Capitolato Tecnico):** che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;
- 5) **Disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- 6) **CS (Capitolato speciale):** il presente documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- 7) **DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- 8) **Ordinativo di fornitura:** documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontà di acquisire i beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CS;
- 9) **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- 10) **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016** avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i riordini della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- **DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di fornitura;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CS e nel CT e nel capitolato generale;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i.:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera

consistente la concorrenza. E' fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Art. 2 – OBIETTIVI, OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E OPZIONE D'ACQUISTO

Con la fornitura oggetto del presente CSA questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende procedere all'acquisizione di arredi per varie UU.OO. con l'obiettivo di:

- Perseguire il raggiungimento dei Lea, come attestato dalla Direzione Medica di Presidio nella relazione tecnico estimativa;
- Ottimizzare il confort alberghiero al fine di una maggiore umanizzazione dei luoghi di cura e degli ambienti di lavoro, come previsto dall'Atto Aziendale (ex. art. 28); a tal fine la Direzione include nel novero degli investimenti anche i beni di supporto alle attività istituzionali quali gli arredi ad essa funzionali.

Il presente CS ha per oggetto la fornitura di arredi e relativi servizi accessori quali trasporto, consegna nelle sedi di destinazione, assemblaggio ed installazione e posa in opera a regola d'arte, per le varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

La fornitura è suddivisa in n. 5 lotti distinti:

- ✓ Lotto 1 – arredo tecnico;
- ✓ Lotto 2 – arredo sanitario;
- ✓ Lotto 3 – arredo degenza;
- ✓ Lotto 4 – carrelli;
- ✓ Lotto 5 – barelle.

Per la descrizione analitica della fornitura e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia al CT.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 793.000,00 Iva esclusa così suddiviso:

(Tabella 1)

LOTTE	IMPORTO A BASE D'ASTA DEL LOTTO IVA ESCLUSA (col. A)	Opzione d'acquisto IVA esclusa (col. B)	IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL LOTTO, IVA ESCLUSA (somma col. A + col. B)
<i>Lotto 1) Arredo in acciaio</i>	<i>€ 110.000,00</i>	<i>€ 88.000,00</i>	<i>€ 198.000,00</i>
<i>Lotto 2) Arredo sanitario</i>	<i>€ 175.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>	<i>€ 275.000,00</i>
<i>Lotto 3) Arredo degenza</i>	<i>€ 145.000,00</i>	<i>€ 116.000,00</i>	<i>€ 261.000,00</i>
<i>Lotto 4) Carrelli</i>	<i>€ 25.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>	<i>€ 35.000,00</i>
<i>Lotto 5) Barelle</i>	<i>€ 12.000,00</i>	<i>€ 12.000,00</i>	<i>€ 24.000,00</i>

La posa in opera si intende a regola d'arte e comprensiva di tutto quanto occorra a garantire la perfetta funzionalità dei beni forniti che dovranno essere realizzati su misura ed adattarsi perfettamente alle destinazioni d'uso.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle vigenti normative in materia, alle caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o superiore a quelle indicate nel CT (all.n. 1 del presente Capitolato Speciale) o **equivalenti** e dovranno essere conformi alle esigenze dei servizi utilizzatori di questa SA.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere privi di difetti intrinseci.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati negli atti di gara, allo scopo di rendere gli allestimenti perfettamente operativi e rispondenti alle finalità proprie.

Si precisa che le misure riportate per gli arredi sono indicative, devono pertanto essere verificate, prima della messa in produzione, previo sopralluogo obbligatorio dei locali da arredare.

Opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c.

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione definitiva degli arredi dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico per le quantità ivi indicate riservandosi sin d'ora di procedere, entro 24 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all'acquisto dall'operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi di arredi con caratteristiche identiche a quelle dei prodotti aggiudicati per un importo massimo pari al valore sopra indicato quale "opzione d'acquisto" (cfr. *Tabella 1, col. B*).

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di arredi alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.

L'opzione di acquisto è subordinata:

- all'emergere di ulteriori necessità;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. **l'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 793.000,00 Iva esclusa** (di cui € 467.000,00 Iva esclusa per la fornitura degli arredi oggetto del CT ed ulteriori € 326.000,00 Iva esclusa per l'eventuale acquisto di ulteriori arredi).

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per l'eventuale mancata attivazione della suddetta opzione di acquisto da parte di questa Azienda.

Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà di questa Azienda di procedere alla variante dei contratti qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Si evidenzia sin d'ora che in caso di esercizio dell'opzione d'acquisto questa Azienda procederà ad emettere ordinativo di fornitura avente un numero CIG diverso da quello del lotto di riferimento; ciò in ottemperanza a quanto previsto da ANAC nella *FAQ n. 449 - Sezione: obblighi informativi verso l'Autorità*.

Fuori produzione:

Si precisa che ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei codici dei prodotti offerti in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica di questa SA.

A tal proposito si evidenzia che l'impresa aggiudicataria potrà non fornire il prodotto offerto in sede di gara e le parti di ricambio solo in caso di sopravvenuta "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare al Responsabile Unico del Procedimento:

- ✓ dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente ovvero dal produttore (se diverso dal Contraente);
- ✓ dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal Contraente con l'indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione";
- ✓ tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto offerto in sostituzione già richiesta e prodotta per il prodotto fuori produzione.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti, questa SA procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione" anche mediante la visione di un campione che l'impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta per essere sottoposto a valutazione di conformità. La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dell'impresa aggiudicataria.

A seguito dell'analisi delle dichiarazioni di cui sopra e dell'analisi effettuata sul prodotto offerto in sostituzione è facoltà di questa SA:

- accettare il nuovo prodotto corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara;
- rifiutare il nuovo prodotto, quando con proprio giudizio insindacabile la SA lo giudichi non perfettamente rispondente alle caratteristiche previste dal capitolato e rispondenti alle esigenze di questa SA e recedere in tutto o in parte dal contratto. In caso di recessione parziale rimane fermo il diritto per la SA di acquistare presso altro operatore economico il prodotto occorrente a danno dell'impresa aggiudicataria restando a carico di quest'ultima sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Tutti i materiali usati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia.

Gli arredi e/o i componenti saranno consegnati nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare.

Deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, in danno all'Impresa aggiudicataria.

Art. 3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' **obbligo dell'impresa aggiudicataria** effettuare, prima della messa in produzione degli arredi, il sopralluogo delle sedi e dei locali di destinazione al fine di:

- rilevare le misure esatte degli spazi disponibili;
- concordare con i rispettivi Coordinatori Infermieristici di reparto i colori degli arredi da fornire.

Non si assumono pertanto responsabilità per eventuali criticità si riscontrassero all'atto dell'installazione degli arredi.

Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale richiamando l'impresa aggiudicataria a quanto previsto dal successivo art. 4 –consegna e installazione.

Art. 4 –CONSEGNA E INSTALLAZIONE

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il servizio di consegna e allestimento è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti l'imballaggio, il trasporto al piano, l'assemblaggio e l'installazione a regola d'arte.

Gli arredi dovranno essere consegnati, assemblati, installati e pronti all'uso entro e non oltre **40 (quaranta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.**

Questa Azienda si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 del art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

Gli arredi devono essere consegnati e montati, completi in ogni parte, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria nelle seguenti sedi dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord:

- **UOC Anatomia Patologica – P.O. San Salvatore – Pad. I – Primo livello;**
- **Poliambulatori – P.O. San Salvatore – Pad. I – Secondo livello;**
- **U.O.C Chirurgia - P.O. San Salvatore di Pesaro – Pad. A – Primo piano;**
- **U.O.C. Neurologia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. H – Primo piano;**
- **U.O.C Ortopedia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. A Secondo piano;**
- **Servizi vari (varie sedi aziendali Pesaro/Fano).**

Potrebbe altresì essere concordata la fornitura parziale di alcuni arredi, o parti di essi, prontamente utilizzabili. L'impresa aggiudicataria non potrà pretendere maggiori compensi in dette anticipazioni di consegna.

L'ultimazione della fornitura si considererà avvenuta solo dopo aver constatato che tutti gli arredi di cui ai rispettivi ordinativi, siano stati forniti correttamente e definitivamente installati e pronti all'uso.

La SA, ove al momento dell'ordine non sia in grado di indicare tutti i locali destinatari, comunicherà alla ditta in forma scritta, prima del giorno fissato per la consegna, gli elenchi dei rimanenti ambienti.

Entro lo stesso termine, la SA si riserva la facoltà di effettuare modifiche alle destinazioni indicate negli elenchi inizialmente trasmessi, fermo restando l'obbligo della ditta aggiudicataria di provvedere al montaggio.

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria dare preventiva comunicazione scritta ai referenti delle rispettive UU.OO. che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura, al RUP ed al DEC, del programma di installazione degli arredi in modo da consentire il coordinamento con le esigenze dei vari servizi sanitari e/o con la tempistica dei lavori.

Qualora la consegna venga ultimata in ritardo rispetto ai tempi sopra indicati la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art.13 del presente Capitolato speciale. In caso di ritardi superiori a 20 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione sopra indicati, questa SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c. come previsto dal successivo art. 15 del presente Capitolato Speciale.

Restano a carico dell'impresa aggiudicataria:

- il trasporto;
- il trasferimento dei materiali a piè d'opera al locale di installazione, compreso l'utilizzo di eventuali macchine di sollevamento, aperture nelle pareti e relativo ripristino, ecc.;
- l'imballaggio e il suo smaltimento;
- l'installazione ed il montaggio a regola d'arte;
- la guardiania dei materiali fino all'attestazione, con esito favorevole, di regolare esecuzione;
- l'assistenza ad eventuali collaudi previsti;
- servizio di assistenza full-risk per la durata del periodo di garanzia.

Art. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.l.gs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

Il DEC potrà nominare i referenti per la consegna (es. Coordinatori dei reparti) i quali dovranno procedere alla sottoscrizione dei documenti di trasporto, ai controlli previsti dall'art. 6 del presente capitolato speciale e provvedere ad attivare gli interventi post garanzia di cui all'art. 8 del presente capitolato speciale.

Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto sopra esposto il DEC, al termine della consegna ed installazione degli arredi aggiudicati ed ordinati provvede a rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni

Art. 6 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

In occasione della consegna, che deve obbligatoriamente avvenire previo accordo con il DEC o con il referente indicato nell'ordine, verrà sottoscritto da quest'ultimo il documento di trasporto di trasporto (DDT) che dovrà riportare l'elenco dettagliato dei colli e la tipologia di arredo in esso contenuto. All'atto della consegna della fornitura dovrà essere rilasciata al referente incaricato tutta la documentazione (manuali d'uso e manutenzione).

La firma, posta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Considerata infatti l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L'aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse risultare **non conforme** a quelli aggiudicati.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata all'aggiudicatario che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 20 (venti) giorni naturali, consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax); qualora la sostituzione venga effettuata in ritardo rispetto ai termini sopra indicati la SA si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato speciale.
- restituire la merce all'aggiudicatario, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino ai locali di destinazione indicati sull'ordine.

L'aggiudicatario deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte della SA per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte di questa SA non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera lo stesso dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art. 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente descritte nel presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati (nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l'incarico è affidato a soggetti esterni) al fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle installazioni effettuate.

Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene effettuata l'attività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i componenti e conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri effettivamente designati.

Il R.U.P. trasmette progressivamente al soggetto incaricato della verifica di conformità:

1. la copia della documentazione tecnica dei prodotti aggiudicati oggetto della fornitura;
2. copia del contratto sottoscritto;
3. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità/ecc.,
4. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Esaminati i documenti acquisiti il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno della/e visita/e di verifica di conformità e ne informa il R.U.P. che ne dà tempestivo avviso all'aggiudicatario e

al DEC.

Le prove funzionali sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno obbligatoriamente essere effettuate in contraddittorio alla presenza del soggetto incaricato della verifica di conformità e del DEC.

Se l'aggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di conformità, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la relativa spesa è posta a carico dell'aggiudicatario.

Il DEC ha l'obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformità.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

Le verifiche previste sono le seguenti:

1) **Verifica documentale o fase preliminare** nella quale viene accertata la rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico, dal progetto presentato dall'impresa aggiudicataria in sede di gara ed a quanto aggiudicato ed ordinato;

2) **Verifica Operativa o fase di collaudo** destinata a verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche da parte dell'esecutore indicando la collaudabilità o meno della fornitura. Si procederà pertanto alla verifica della qualità complessiva della fornitura e della relativa funzionalità;

3) **Esito del collaudo o fase conclusiva** nella quale il collaudatore decide alternativamente:

- a) **accettazione** delle prestazioni in caso di piena e regolare rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni di contratto; in tale ipotesi si procederà pertanto con il rilascio del certificato di verifica di conformità;
- b) **rinvio** dell'esito conclusivo **ossia il verificatore sospende la verifica** con assegnazione all'esecutore di un termine ad adempiere in caso di difetti o lievi mancanze che qualora sanati, rendano comunque collaudabili le prestazioni eseguite; in tale ipotesi l'esecutore (impresa aggiudicataria) sarà tenuto ad ottemperare alla predetta richiesta al fine di una nuova verifica. Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte;
- c) emissione di **un'autorizzazione provvisoria** all'uso se la mancanza di una o più condizioni non pregiudicano la funzionalità dell'intera fornitura; in tal caso **il verificatore sospende la verifica** e prescrive specificamente le attività da porre in essere con assegnazione all'esecutore di un termine ad adempiere. Il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescritte;
- d) **rifiuto** delle prestazioni in caso di gravi difetti o mancanze rispetto alla prescrizioni del contratto. In tale ipotesi non si procederà all'emissione del certificato di verifica di conformità ed il verificatore trasmette al RUP il verbale corredata di dettagliata relazione per i successivi provvedimenti che il RUP valuterà di proporre alla SA (risoluzione contrattuale, incameramento della cauzione definitiva, ecc.).

La durata massima delle sospensioni di cui ai punti b) e c) è fissata in 20 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, in caso quindi di esito anche solo parzialmente negativo del collaudo verrà applicata all'impresa aggiudicataria, per ogni giorno intercorso dalla data del relativo verbale di collaudo e fino alla data della nuova installazione di arredi conformi alle caratteristiche richieste, una penalità giornaliera nella misura di cui al successivo art. 13 del Capitolato Speciale

L'impresa aggiudicataria provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare gli arredi/complementi d'arredo non conformi entro 15 giorni naturali consecutivi dalla data di sospensione del collaudo. Si intendono a carico dell'aggiudicatario stesso gli oneri derivanti dai disservizi provocati dalla mancata installazione che verranno quantificati dalla SA.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di verifica di conformità, compreso l'assemblaggio e l'installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell'aggiudicatario.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il verificatore, qualora ritenga collaudabile la fornitura emette il **certificato di verifica di conformità**) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – SERVIZIO DI POST VENDITA IN REGIME DI GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella documentazione tecnica.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita in garanzia minimo pari a 24 mesi ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura formalizzata mediante sottoscrizione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.7 del presente capitolato speciale. La garanzia post-vendita comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.

L'impresa aggiudicataria non è svincolata da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente all'esito positivo del collaudo. In tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art.1668 c.c., l'impresa aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da altre cause; inoltre l'impresa aggiudicataria, in tale periodo è garante delle forniture eseguite e si obbliga a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza all'uso, finché corretto, dei beni.

Gli interventi di garanzia/ripristino atti ad assicurare la funzionalità degli arredi, dovranno essere effettuati entro 72 ore dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione della penalità previste al successivo art. 13 del presente capitolato speciale. In caso di impossibilità di ripristino dell'efficienza del bene, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione dell'arredo o complementi d'arredo entro 10 giorni (dieci) lavorativi dal primo intervento, pena l'applicazione delle penalità previste dal successivo art. 13 del presente capitolato speciale.

Nulla è dovuto in ordine al servizio sopra descritto intendendosi compreso nel corrispettivo contrattuale, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo incaricato) e dal Tecnico incaricato dall'impresa aggiudicataria da quale risulti:

- n° dell'ordinativo di fornitura;
- l'ora e il giorno della richiesta di intervento;
- n° dell'intervento;
- l'ora e il giorno dell'intervento;
- descrizione dell'intervento;
- l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura del tempo;
- uso improprio e/o manomissione degli arredi;
- cause di forza maggiore.

Nell'ipotesi in cui si verificano identici eventi di guasti/rotture sulla medesima tipologia di arredo/componente, con conseguente richiesta di intervento (n. 3 eventi per ciascun anno di garanzia), la SA si riserva di applicare le penali previste dall'art. 13 del presente capitolato speciale nelle misure ivi indicate.

Art. 9 – CORRISPETTIVO, ONERI CONTRATTUALI E NORME DI SICUREZZA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it/> nella sezione "Bandi e avvisi di gara", che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.L.

I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari a zero**.

Art. 10 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

I prezzi offerti, indicati nei rispettivi moduli offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

L'impresa aggiudicataria fatturerà gli importi inerenti la fornitura aggiudicata, comprensiva dei servizi connessi e specificatamente disciplinate nel presente capitolato, a seguito di emissione dell'ordinativo di fornitura, successivamente alla consegna.

Ogni fattura deve essere accompagnata da bolla di consegna. Il DDT dovrà riportare la firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Incaricato in qualità di referente per la consegna.

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procederà come segue:

- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformità il RUP emetterà il **certificato di pagamento;**
- il certificato di pagamento verrà notificato all'aggiudicatario a mezzo pec;

- solo a seguito della comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potrà emettere la relativa fattura;
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 12 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti come segue:

(l'impresa aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte della S.A)

Parametro di valutazione	Penale	Modalità di applicazione
Termine per l'ultimazione dell'installazione (art. 4 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura mancante	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per la sostituzione di arredi e complementi d'arredo non conformi (art. 5 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura da sostituire	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per l'effettuazione dell'intervento di assistenza post-vendita: riparazione/sostituzione (art. 8 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura oggetto dell'intervento	Per ogni ora solare di ritardo nell'intervento. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e installazione di arredo sostituito.
In caso del verificarsi di n. 3 identici eventi sulla medesima tipologia di arredo/componenti (art. 8 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale	

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento di comunicazione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accettabili dalla SA, ovvero pervengano in ritardo rispetto al termine sopra indicato, saranno applicate al fornitore le relative penali a decorrere dall'inadempimento. L'applicazione delle penali previste da presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rimane fermo comunque per la SA il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno dell'aggiudicatario qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incarnerà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

➤ la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.
➤ la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;
➤ la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
➤ la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

La Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; diritto, qualora:
L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di

deff'importo contrattuale; ecc).
in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).
L'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate mancata rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per

➤ dall'art. 4 del presente capitolato;
➤ in caso di ritardi superiori a 20 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione previsti

➤ in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).
➤ mancata adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

➤ violazione del patto di integrità;
➤ rapporto contrattuale con gli altri soci;
➤ di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il

➤ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o della Ditta aggiudicataria;
➤ di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico

➤ in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, cessione del contratto;
➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
➤ subappalto non autorizzato;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ subappalto non autorizzato;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

➤ subappalto non autorizzato;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

➤ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la SA potrà ordinare ad altro operatore economico

relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla SA.

Per il risarcimento dei danni, la SA potrà rivalersi, mediante trattative sugli eventuali crediti dell'impresa

aggiudicataria ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere

immediatamente reintegrato.

Il prezzo dei prodotti così acquistati.

Questa SA si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che

l'Ufficio Legale riterrà opportuno.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Azienda si riserva di non procedere alla sottoscrizione del contratto con la/e società aggiudicataria/e qualora, nelle more della medesima sottoscrizione, venga avviata una convenzione Consip o aggiudicata dal soggetto aggregatore una fornitura avente condizioni economiche migliorative. L'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1 del presente capitolato speciale è subordinato alla verifica dell'assenza di convenzione Consip o di fornitura aggiudicata dal soggetto aggregatore avente condizioni economiche migliorative.

Art. 17 TUTELA AZIONI CONTRO TERZI

L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore. L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti di questa SA in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 19 RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Al n° 5
CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER
LE VARIE UU.OO DI QUESTA AZIENDA

ALLEGATO N° 5 ALLA DETERMINA N° 102
SPECIFICHE GENERALI PER TUTTI I LOTTI - 9 FEB. 2007 DMPOSTO DI N° 86 PAGA

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al principio di equivalenza di cui al D.Lgs. 50/2016, pertanto il Concorrente sarà libero di proporre gli arredi, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'Ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato di gara. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle caratteristiche tecniche.

Gli arredi di seguito indicati dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- garantire le caratteristiche di usabilità, robustezza, sicurezza, igienicità;
- i materiali dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili con i prodotti di uso ospedaliero (ad es. disinfettanti cloroderivati, clorexidina, fenoli, ecc.);
- i materiali, inoltre, dovranno essere latex free e conformi a tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- i rivestimenti dovranno essere omologati e classificati per la reazione al fuoco dei materiali in classe 1 IM (ai sensi del DM 18 settembre 2002);
- le imbottiture e i materiali plastici dovranno essere autoestinguenti ed atossici, le vernici e le colle dovranno essere atossiche, i vetri dovranno essere antisfondamento e gli specchi antinfortunistici;

Le finiture ed i colori saranno scelti dopo l'aggiudicazione e prima di emettere i relativi ordini.

Le dimensioni degli articoli richiesti sono indicative e dovranno essere verificate in sito dalla Ditta aggiudicataria al fine di fornire i complementi idonei ad essere collocati negli spazi effettivi e reali

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà verificare e rilevare le predisposizioni impiantistiche (elettriche ed idrauliche) esistenti e provvedere ai necessari collegamenti.

La Ditta concorrente dovrà essere disponibile, qualora la Commissione giudicatrice lo ritenga necessario ai fini della valutazione del prodotto, a fornire in prova campioni degli arredi offerti.

SPECIFICHE PARTICOLARI PER IL LOTTO N. 1

- i materiali e le finiture degli arredi devono avere caratteristiche specifiche per il laboratorio, al fine di garantire la resistenza chimico-meccanica e la decontaminazione delle superfici;
- i banchi da laboratorio devono essere certificati secondo la norma europea EN13150, relativa a "Banchi da lavoro per laboratorio: dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova";
- la struttura delle postazioni di lavoro deve essere interamente indipendente dal modulo tecnico, deve essere provvista di spalle laterali a C; la rigidità strutturale, garantita dal telaio e dai traversi orizzontali, deve essere testata e certificata, con una capacità di carico uniformemente distribuito di almeno a 200 kg/mq;
- le ruote girevoli dei moduli e dei mobili devono essere dotate di dispositivo di freno a pedale sul fronte di lavoro;
- i mobili devono essere certificati secondo la norma europea EN-14727: "Mobili contenitori per laboratorio: requisiti e metodi di prova";
- il corpo dei mobili deve essere costruito con pannelli di nobilitato melaminico, di tipo ignifugo classe B-s1, d0 secondo le norme EN-13501-1;
- ante e cassetti devono essere provvisti di maniglie in materiale di facile pulizia;
- i profili di chiusura dei mobili devono essere dotati di guarnizione anti-polvere;
- le cerniere devono avere una apertura totale con angolo di 180°;
- le cassettiere e le ante devono essere complete di serratura a chiave;
- le cassettiere devono essere e dotate sistema anti-tilting per il blocco dei cassetti;
- i piani di lavoro devono essere realizzati in materiale Dupont TM Corian certificato, antigraffio, antimacchia e resistente all'abrasione;
- il fissaggio dei mobili pensili e delle mensole è richiesto su pareti in cartongesso e/o su pareti tecniche con montanti di supporto.

SI EVIDENZIA E' ONERE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA PROVVEDERE, OVE RICHiesto, AL TRASFERIMENTO (SMONTAGGIO INCLUSO) DEGLI ARREDI ESISTENTI IN AZIENDA PRESSO I NUOVI LOCALI DI DESTINAZIONE (indicati di seguito nel presente capitolato) E CONSEGUENTE ADEGAUMENTO E INSTALLAZIONE DEGLI STESSI (come meglio precisato nel capitolato speciale di gara- ex. art. ____).

LOTTO 1 - ARREDO TECNICO - Importo a base d'asta € 110.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE ANATOMIA	DESCRIZIONE	Qu.tà
LABORATORIO MOLECOLARE 03 ANATOMIA PATOLOGICA	Parete attrezzata per laboratorio a doppia elle mm L 2400 più 2000 più 2300 di seguito descritta	1
	Parete a dx lato finestra rispetto all'ingresso mm L 2400 P800 così composta:	
	Banco di lavoro con piano di appoggio H 860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato , sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.	
	<u>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</u>	
	N. 1 mobile base sottopiano con anta su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico . Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati dimensioni circa mm L 600 P 800	
	N.1 lavello da incasso in materiale Dupont TM Corian certificato con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno dimensioni vasca circa mm L 400 P400	
	N.1 rubinetto miscelatore monocomando monoforo , con bocca girevole con comando a gomito.	
	N.1 mobile base sottolavello su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L400 P 800.	
	N. 1 piano lavoro contiguo per cappa su ruote in materiale Dupont TM Corian certificato sotto aperto dimensioni mm L 800 P800	
	N.1 mobile base sottopiano su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L600 P800.	
	Parete attrezzata centrale lato finestra rispetto all'ingresso dotata di pannello e supporto per pensili mm L 2000 P 800 H circa 2500 così composta :	1

Banco di lavoro con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.	
<u>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</u>	
N. 1 piano lavoro contiguo su ruote in materiale Dupont TM Corian certificato sotto aperto dimensioni mm L 600 P800	
N.1 mobile base sottopiano su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L900 P800 .	
<u>Sopra il piano parete attrezzata centrale</u>	
N. 1 pannello tecnico per laboratorio	
N.1 mobile pensile a due ante in vetro temperato realizzate in tecnopolimero. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 900 P 350 H 500	
Parete attrezzata centrale lato ingresso "speculare alla precedente" dotata di pannello tecnico e supporto per pensili mm L 2000 P 800 H circa 2500 così composta :	1
Banco di lavoro con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato , sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C. Banco di lavoro H 860	
<u>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</u>	
N.1 mobile base sottopiano su ruote scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L.900 P650.	
N. 1 piano di lavoro contiguo su ruote in materiale Dupont TM Corian certificato sotto aperto dimensioni mm L 600 P 800	
N. 1 piano lavoro ad angolo in materiale Dupont TM Corian certificato dimensioni circa mm L400	
<u>Parete attrezzata lato dx lato all'ingresso così composta :</u>	
Banco di lavoro con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato , sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C	

	<u>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</u>	
	N.1 mobile base sottopiano su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L.900 P.650.	
	N. 1 piano di lavoro contiguo per cappa su ruote in materiale Dupont TM Corian certificato sotto aperto dimensioni mm L 900 P800	
	<u>Sopra il piano parete attrezzata centrale lato ingresso</u>	
	N. 1 pannello tecnico per laboratorio	
	N.1 mobile pensile a due ante in vetro temperato realizzate in tecnopolimero. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 900 P 350 H 500	
LABORATORIO IMMUNOLOGIA 04 - ANATOMIA PATOLOGICA	TRASFERIRE ED ADATTARE ARREDI GIA' PRESENTI IN AZIENDA	
	Lavandino Dotato di una vasca dimensioni mm L 450P 350 H 200 e gocciolatoio a dx in materiale Dupont TM Corian certificato.	1
	Rubinetto miscelatore 1 Monocomando monoforo con bocca girevole.	1
	Mobile base sottolavello N. 1 su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, dimensioni circa mm L.900 P 650.	1
LABORATORIO INCLUSIONE 05 - ANATOMIA PATOLOGICA	Parte attrezzata di dimensioni circa mm L 2400 P800 così composta :	1
	Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato , sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.	
	<u>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</u>	
	N. 2 Mobile base sottopiano su ruote Scocca in nobilitato spessore 20 mm dotato di un cassetto estraibile (per il contenimento della cera) il frontale del cassetto deve essere in tecnopolimero, lavabile, disinfettabile, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 450 P 480	
	<u>Sopra il piano</u>	

	N. 1 Pannello tecnico per laboratorio. Struttura attrezzata con montanti in metallo per fissaggio mensole.	
	N. 2 Mensole Adatte al lavoro di laboratorio supportate da colonnine porta mensole Dimensioni mm L 1200 P350 .	
	Parte attrezzata di dimensioni circa mm circa mm L3000 P800 (H riferita all' del Piano di lavoro così composta :	1
	Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.	
	Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:	
	Mobile base sottopiano su ruote N.2 Scocca in nobilitato spessore 20 mm dotato di un cassetto estraibile (per il contenimento della cera) il frontale del cassetto deve essere in tecnopolimero, lavabile, disinfettabile, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L. 450 P 480	
	Sopra il piano	
	Pannello tecnico per laboratorio N. 1 Struttura attrezzata con montanti in metallo per fissaggio mensole	
	Mensole N.2 Adatte al lavoro di laboratorio supportate da colonnine porta mensole Dimensioni mm L. 1500 P350 .	
	Mobile sottopiano su ruote N.1 Scocca in nobilitato spessore 20 mm con 4 cassette, i frontali dei cassette dovranno essere in tecnopolimero, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Maniglie ergonomiche. Dimensioni circa mm L. 450 P 480	
LABORATORIO TAGLIO 09 - ANATOMIA PATOLOGICA	Lavandino Dotato di una vasca dimensioni mm L. 400 P 400 in materiale Dupont TM Corian certificato.	1
	Rubinetto miscelatore monocomando monoforo con bocca girevole.	1
	Mobile base sottolavello su ruote scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero; predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Maniglia ergonomica. Privò di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati, con top in materiale Dupont TM Corian certificato. Dimensioni mm L600 P650	1

<p>Mobile base su ruote Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dimensioni circa mm L1200 P480 H 750.</p>	1
<p>Mobile pensile a due ante in vetro temperato realizzate in tecnopolimero . Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati.</p>	2
<p>Tavolo lavoro su ruote Struttura portante in alluminio e acciaio inox. Ruote gemellari dotate di freno. Paracolpi posteriori. Piano in corian profondità circa mm 600. N. 1 cassettera a tre cassette con frontale in tecnopolimero , dotata di serratura. N. 1 supporto per PC. N. 1 canalina passacavi .</p>	1
<p>Parte attrezzata di dimensioni circa mm L3000 P800 così composta :</p>	3
<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio, H860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.</p>	
<p>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</p>	
<p>Mobile sotto banco su ruote N.2 Scocca in nobilitato melaminico spessore 20 mm dotato di un cassetto superiore con serratura ed un anta inferiore; le ante e il frontale del cassetto dovranno essere in tecnopolimero , arrotondato nei bordi e privo di spigoli, l'anta deve essere dotata di ripiano regolabile in altezza . Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	
<p>Sopra il piano</p>	
<p>Pannello tecnico per laboratorio N. 1 Struttura attrezzata con montanti in metallo per fissaggio mensole</p>	
<p>Mensole N.2 Adatte al lavoro di laboratorio supportate da colonnine porta mensole Dimensioni mm L 1500 P350 .</p>	
<p>Carrello porta CPU N. 2 In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	
<p>Supporto per monitor N. 2</p>	
<p>Parte attrezzata di dimensioni circa mm L2000 P800 così composta :</p>	1

**ANATOMIA
PATOLOGICA**

<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H 860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.</p>	
<p>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</p>	
<p>Mobile sotto banco su ruote N.1 Scocca in nobilitato melamminico spessore 20 mm con 4 cassette con serratura, i frontali dei cassette dovranno essere in tecnopolimero, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Maniglie ergonomiche. Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	
<p>Mobile sotto banco su ruote N.1 Scocca in nobilitato melaminico spessore 20 mm dotato di un cassetto superiore con serratura ed un anta inferiore; le ante e il frontale del cassetto dovranno essere in tecnopolimero , arrotondato nei bordi e privo di spigoli, l'anta deve essere dotata di ripiano regolabile in altezza . Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	
<p>Carrello porta CPU N. 1 In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	
<p>Mobile Pensile a due ante N. 2 In tecnopolimero, all'interno un ripiano regolabile in altezza Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 900 P 350 H 500</p>	
<p>Parte attrezzata di dimensioni circa mm L1800 P800 così composta :</p>	1
<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H 860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C. Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</p>	
<p>Mobile sotto banco su ruote N.1 Scocca in nobilitato melamminico spessore 20 mm con 4 cassette con serratura, i frontali dei cassette dovranno essere in tecnopolimero, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Maniglie ergonomiche. Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	
<p>Mobile Pensile a due ante N. 2 Ante in vetro temperato realizzate in tecnopolimero . Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 900 P 350 H 500</p>	

**ACCETTAZIONE
INTERNI 12 -
ANATOMIA
PATOLOGICA**

	<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.</p> <p>Dimensioni circa mm 2000 P600 H860</p>	
	<p>Tavolo lavoro su ruote N . 1</p> <p>Struttura portante in alluminio e acciaio inox.</p> <p>Ruote gemellari dotate di freno.</p> <p>Paracolpi posteriori.</p> <p>Piano in corian profondità circa mm 600.</p> <p>N. 1 cassetiera a tre cassette con frontale in tecnopolimero , dotata di serratura.</p> <p>N. 1 supporto per PC.</p> <p>N. 1 canalina passacavi .</p> <p>Dimensioni circa mm L1000 /1200 P615 H760.</p>	
LABORATORIO 27 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Parte attrezzata di dimensioni circa mm L1500 P800 così composta :</p>	1
	<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H 860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.</p> <p>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</p>	
	<p>Mobile sotto banco su ruote N.1</p> <p>Scocca in nobilitato melaminico spessore 20 mm dotato di un cassetto superiore con inclusa serratura ed un anta inferiore; le ante e il frontale del cassetto dovranno essere in tecnopolimero , arrotondato nei bordi e privo di spigoli, l'anta deve essere dotata di ripiano regolabile in altezza .</p> <p>Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	
	<p>Parte attrezzata ad elle totale mm L 2400 più 2200 così composta :</p>	1
	<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio H 860 realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C.</p> <p>Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:</p>	
	<p>Mobile sottopiano su ruote N.1</p> <p>Scocca in nobilitato melamminico spessore 20 mm con 4 cassette con serratura, i frontali dei cassette dovranno essere in tecnopolimero, arrotondato nei bordi e privo di spigoli.</p> <p>Maniglie ergonomiche.</p> <p>Dimensioni circa mm L 450 P 480</p>	

	<p>Mobile sottopiano su ruote N.1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dimensioni circa mm L900 P480</p>	
	<p>Mobile sottopiano su ruote N.1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati Dimensioni circa mm L. 600 P 480</p>	
	<p>Pensile a due ante N. 4 In tecnopolimero, all'interno un ripiano regolabile in altezza Completo di profilo antipolvere.</p>	
LABORATORIO COLORAZIONI 29	<p>Parete attrezzata di dimensioni circa L 4300 P800 così composta :</p>	1
	<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri essiccate e pulite di ossidazione per il telaio, da essere montate in modo Sotto i telai dovranno essere alloggiati:</p>	
	<p>Lavandino N. 1 Dotato di una vasca dimensioni mm L 400 P 400 in materiale Dupont TM Corian certificato.</p>	
	<p>Rubinetto miscelatore N.1 monocomando monoforo con bocca girevole.</p>	
	<p>Base sottolavello su ruote N. 1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dimensioni mm L400 P650</p>	
	<p>Mobile sottopiano su ruote N:4 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati Dimensioni circa mm L 900 P 480</p>	
	<p>Mobile sottopiano su ruote N:1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati Dimensioni circa mm L450 P 480</p>	

<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C. Dimensioni circa mm L2400 P800 H 860</p>	1
Sotto i telai dovranno essere alloggiati:	
<p>Mobile sottopiano su ruote N:1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati</p>	
Sopra il piano	
<p>Pannello tecnico per laboratorio N. 1 Struttura attrezzata con montanti in metallo per fissaggio mensole</p>	
<p>Mensole in N.2 Adatte al lavoro di laboratorio supportate da colonnine porta mensole Dimensioni mm L 800 P350 .</p>	
<p>Banco di lavoro a parete con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C. Dimensioni circa mm L2400 P800 H 860</p>	1
Sopra il piano parete attrezzata	
N. 1 pannello tecnico per laboratorio	
<p>N.2 mobili pensili a due ante in vetro temperato realizzate in tecnopolimero. Completi di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotati di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Dimensioni circa mm L 900 P 350 H 500</p>	
Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:	
<p>Mobile sottopiano su ruote N. 1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi,</p>	
<p>Carrello porta CPU N. 2 In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	
<p>Banco di lavoro (per il centro della stanza) con piano di appoggio realizzato in materiale Dupont TM Corian certificato, sostenuto da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche completo di supporti per piani ; il telaio deve essere sostenuto da gambe a C. Dimensioni circa mm L1800 P800 H 860</p>	1

Sotto il telaio dovranno essere alloggiati:	
Mobile sottopiano su ruote N.1 Scocca in nobilitato melaminico spessore 20 mm dotato di un cassetto superiore con inclusa serratura ed un anta inferiore; le ante e il frontale del cassetto dovranno essere in tecnopolimero, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, l'anta deve essere dotata di ripiano regolabile in altezza. Dimensioni circa mm L 450 P 480	
Mobile sottopiano su ruote N.1 Scocca realizzata in nobilitato melaminico. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Privo di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati Dimensioni circa mm L 900 P 480	

FINE ELENCO PER ANATOMIA PATOLOGICA

LOTTO 2 - ARREDO SANITARIO - Importo a base d'asta € 175.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE ANATOMIA	DESCRIZIONE	Qu.tà
DEPOSITO 01 - ANATOMIA PATOLOGICA	Mobile base su ruote Scocca in nobilitato melaminico spessore 20 mm, ante in tecnopolimero rigido, ignifugo in classe 1, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli. Due ante con maniglia ergonomica e con ripiano all'interno regolabile in altezza. Dimensioni circa mm L1200 P480 H 750	1
	Appendiabiti a muro Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti.	2
LABORATORIO MOLECOLARE 03 ANATOMIA PATOLOGICA	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	2
LABORATORIO IMMUNOLOGIA 04 - ANATOMIA PATOLOGICA	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	2
	.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.	1

LABORATORIO INCLUSIONE 05 - ANATOMIA PATOLOGICA	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 11M di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	4
LABORATORIO TAGLIO 09 - ANATOMIA PATOLOGICA	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2
	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 11M di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	7
LABORATORIO PRELIEVI 11 - ANATOMIA PATOLOGICA	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 11M di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	2
ACCETTAZIONE INTERNI 12 - ANATOMIA PATOLOGICA	Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 11M di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .	2
SEGRETERIA ACCETTAZIONE 13 - ANATOMIA PATOLOGICA	Vetro per aperture lato dx corridoio Le due aperture dovranno essere dotate telaio per supporto del vetro di chiusura; il vetro dovrà essere del tipo antinfortunistico, e dotato di fessura passacarte e passa materiale dimensioni mm L 400 mm H 300. Dimensioni totali disponibili per ciascuna intelaiatura portante del vetro circa mm L. 1000 P 150 H1050	2
	Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L. 1400 P 800 H 750.	4
	Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L. 1000 P 500 H 750.	2

4	<p>Cassiera Socca in nobilitato laminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L.420 P.580 H.600.</p>
4	<p>Carrello porta CPU In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L.250 P.450 H.170.</p>
4	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>
1	<p>Pensile Struttura in MDF con ante in vetro. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Pivò di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni mm L.1600 P.350 H.720</p>
1	<p>Pensile Struttura in MDF con ante in vetro. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Pivò di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni mm L.900 P.350 H.720</p>
1	<p>Casellario Dotato di 50 scomparti aperti disposti in orizzontale su due file Dimensioni circa mm L.1500 P.350 H.500</p>
1	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portanombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>

US 14	<p>Sedia senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo Portata circa 100 kg.</p>	3
LOCALE TECNICO 15 + ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Tavolo da lavoro Ergonomico realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 860</p>	1
	<p>Pensile Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.2 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensione circa mm L 800 P 350 H 630.</p>	2
UFFICIO 17 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2	

	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
UFFICIO 18 - ANATOMIA - PATOLOGICA	<p>Tavolo lavoro ovale per microscopi 10 teste Ergonomico piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotato di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 2400 P 700 H 750.</p>	1
	<p>Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 1IM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggipiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	10
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 700 P 450 H 2000.</p>	1
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
UFFICIO 19 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2

	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassette, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
UFFICIO DIRETTIVO 20 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1

	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p>	2
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
	<p>Pensile Struttura in MDF con antesia a vetro che cieche. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni mm L 1500 P 350 H 720</p>	1
UFFICIO 23	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi.</p>	2
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	2

<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2	
<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2	
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2	
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2	
<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2	
<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1	
<p>Pensile Struttura in MDF con ante sia a vetro che cieche. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni mm L 900 P 350 H 720</p>	2	
<p>UFFICIO 24 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2

	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	1
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
UFFICIO 25	<p>Scrivania su misura Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.(aperture sul piano di lavoro per facilitare l'ingresso della carrozzina o altra modalità di ingresso della stessa, al fine di consentire l'attività all'operatore) Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Con piccola cassettera Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 50.</p>	1

<p>Sgabello basso imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L 360 P 320 H 320</p>	1
<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2
<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	2
<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento.</p>	3
<p>Carrello porta CPU N. 2 In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L 250 P 450 H 170.</p>	1
<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	3

	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 1000 P 450 H 2000.</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce. Altezza max mm 1000</p>	1
UFFICIO 17-19-20-23-24-25 ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Armadio spogliatoio ad un posto Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. <i>Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per</i></p>	11
LAVAGGIO 28	<p>Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1
LABORATORIO COLORAZIONI 29	<p>Sgabello operatore Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	3
SALA RELAX 30	<p>Base con ante Realizzata in nobilitato melaminico, vano con ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 1400 P600 H 850.</p>	1
	<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L. 1400 P350 H 720.</p>	1
	<p>Tavolo Piano in nobilitato rivestito con un film di materiale plastico atossico ad alta resistenza. Gambe con piedini regolabili. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L. 1000 P 600 H 800.</p>	1

	<p>Sedia per tavolo Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>	3
	<p>Poltrona relax Con schienale e poggia gambe reclinabili separatamente. Basamento fisso, con braccioli, schienale e gambe regolabili con comando a gas facilmente raggiungibile. Imbottitura anatomica semirigida e rivestimento in sky lavabile ignifugo. Facilmente lavabile e disinfettabile. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008.</p>	2
UFFICIO 31 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	Porta CPU	2
	Sedia dattilo	2
	Sedia interlocutore senza braccioli	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p>	1
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
UFFICIO CAPOTECNICO 32 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata.</p>	1

	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L.260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. <i>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335</i></p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote senza braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. <i>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335</i></p>	1
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs <i>Cornice in metallo e trattamento anticorrosione</i></p>	1
	<p>.Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	1
SERVIZI IGIENICI - 7 8-22- 33-34	<p>Specchio</p>	5
	<p>Mensola dotata di angoli smussati.</p>	5
	<p>Porta sapone non a rabbocco. Dotato di sistema di erogazione senza contatto. Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.</p>	5
	<p>Dispenser asciugamani a rotolo Dotati di sensore per dispensazione senza contatto delle mani, ad erogazione singola Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.</p>	5
	<p>Appendiabiti a muro Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. <i>Dimensioni: larghezza L 444 P 20 H 170</i></p>	5
	<p>Porta rotolo cartigenica chiuso. Design sigillato e protetto, (l'utente tocca solo la carta che utilizza) Sistema di erogazione singola Chiuso con serratura per proteggere il rotolo Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.</p>	5

SERVIZIO RICHIEDENTE CHIRURGIA	DESCRIZIONE	Qu.tà
GUARDIOLA INFERMIERI PARETE LATO SX Parte inferiore (rispetto all'ingresso) - CHIRURGIA PESARO	Top In corian Dimensioni circa mm L1700 P600.	1
	Base con cassetti Realizzata in nobilitato melaminico, con n.4 cassetti con guide metalliche. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.	1
	Base con ante Realizzata in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 900 P600 H 850	1
GUARDIOLA INFERMIERI PARETE LATO SX Parte superiore (rispetto all'ingresso) - CHIRURGIA PESARO	Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.	2
	Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano a giorno con due ripiani. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.	1
GUARDIOLA INFERMIERI PARETE LATO SX Parte inferiore (rispetto all'ingresso dopo porta Bagno) - CHIRURGIA PESARO	Lavello Da incasso in corian con gocciolatoio a destra con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno.	1
	Rubinetto Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole. Comando a gomito.	1
	Base sottolavello Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.	1

	<p>Base con ante con piano top in corian Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L500 P600 H 890.</p>	1
<p>GUARDIOLA INFERMIERI PARETE LATO SX Parte superiore (rispetto all'ingresso dopo porta Bagno) - CHIRURGIA PESARO</p>	<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.</p>	2
<p>GUARDIOLA INFERMIERI PARETE LATO DX (rispetto all'ingresso) - CHIRURGIA PESARO</p>	<p>Piano di lavoro In corian, con passacavi. Dimensioni circa mm L 2100 P60.</p>	1
	<p>Fiancata terminale per sostegno piano</p>	1
	<p>Gamba Gamba colonna regolabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche diam.80mm.</p>	1
	<p>Staffa Reggi mensola per piano di lavoro in acciaio verniciato con polveri epossidiche.</p>	2
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	2
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
	<p>Sedia interlocutore con braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	1

	<p>Armadio farmaci mm parete 1600 Scocca in nobilitato bilaminato plastico, fondo e fianchi, frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica. Cerniere apertura a 270°. Completo di profilo antipolvere Dotato di serratura con chiave. Dotato di 20 vani sul retro dell'anta e 40 vani interni girevoli dotati di spondine di contenimento dei medicinali in policarbonato trasparente. Dotato di armadietto per stupefacenti munito di serratura antiscasso e anta ribalta Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Dimensione circa mm L 1000 P 500 H 2000</p>	2
CAPOSALA - CHIRURGIA PESARO	<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L.600 P350 H 720.</p>	3
	<p>Piano di lavoro Realizzato in nobilitato melaminico. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 3700 P 800 H 720</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1
	<p>Armadio ad un anta Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con un anta cieca a battente superiore e una inferiore, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza (almeno n 10). Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L 500 P 450 H 2000.</p>	1
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2
	<p>Carrello porta CPU In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L. 250 P 450 H 170.</p>	1

<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	3	
<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2	
<p>MEDICHERIA - CHIRURGIA PESARO</p>	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti; dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1

	<p>Armadio per presidi medici Ante con vetro temperato Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.4 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P450 H 1900</p>	2
STUDIO DIRETTORE - CHIRURGIA PESARO	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
MEDICO DI GUARDIA- CHIRURGIA PESARO	<p>Letto singolo</p>	1
	<p>Comodino</p>	1
	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1600 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1

	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	1
	<p>Armadio spogliatoio ad un posto Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008. Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
MATERIALE VARIO - CHIRURGIA PESARO	<p>Scala doppia con quattro gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antisdrucchiolo; rispondente alle norme di sicurezza.</p>	1
FINE ELENCO PER CHIRURGIA PESARO		
SERVIZIO RICHIEDENTE NEUROLOGIA	DESCRIZIONE	Qu.tà
STUDIO DIRETTORE - NEUROLOGIA PESARO	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1800 P 800 H 750.</p>	1

1	<p>Piano datilo</p> <p>Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dimensioni circa mm L. 1000 P. 500 H. 750.</p>
1	<p>Cassettera</p> <p>In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Con 3 cassette, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa.</p> <p>Con serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Con 4 ruote proiettanti con freno, sistema antiribaltamento.</p> <p>Dimensioni circa mm L.420 P.560 H. 580.</p>
1	<p>Porta CPU</p> <p>Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L. 260 P. 500 H. 570.</p>
1	<p>Sedia datilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spesso imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 11M di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>
2	<p>Sedia intercuttore senza braccioli</p> <p>Imbottita, rivestita in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 11M di reazione al fuoco.</p> <p>Portata circa 100 kg.</p>
2	<p>Armadio libreria</p> <p>Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cicche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Dorato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L. 1000 P. 450 H. 2000.</p>
2	<p>Base con ante</p> <p>Scocca realizzata in nobilitato.</p> <p>Anta in MDF rivestito in tecnopolimero.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Maniglie ergonomiche.</p> <p>Piva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati.</p> <p>Dorata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa.</p> <p>Dimensioni circa mm L. 660 P. 600 H. 890</p>
1	<p>Attaccapanni a colonna</p> <p>Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>

STUDIO MEDICI (4 postazioni) - NEUROLOGIA PESARO	Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.	4
	Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	4
	Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.	4
	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	4
	Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.	2
	Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs. Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.	2
	Attaccapanni a muro Su tavoletta con nr. 2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Dimensioni circa mm L440 P20 H170.	2

	<p>Armadio spogliatoio ad un posto Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008. Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	4
STUDIO MEDICI (3 postazioni) - NEUROLOGIA PESARO	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	3
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	3
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	3
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	3
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2

<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante a vetro battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2
<p>Attaccapanni a muro Su tavoletta con nr. 2 ganci porta abiti.</p>	2
<p>Armadio spogliatoio ad un posto Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008. Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	3
<p>Letto da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati. Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57- massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1

AMBULATORIO - NEUROLOGIA PESARO	Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L. 1200 P 800 H 750.	1
	Piano dattilo Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L. 1000 P 500 H 750.	1
	Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L.420 P560 H 580.	1
	Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.	1
	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1
	Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.	2
	Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 1000 P 450 H 2000.	1
	Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce	1

CAPOSALA - NEUROLOGIA PESARO	Piano di lavoro Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 2800 P 800 H 750.	1
	Pensili Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L600 P350 H 720.	5
	Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.	2
	Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.	1
	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1
GUARDIOLA INFERMIERI - NEUROLOGIA PESARO	Base con ante Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L660 P600 H 890	2
	Lavello N. 1 Da incasso in corian con gocciolatoio a sinistre con vasca completo di piletta, troppo pieno e tubi di raccordo per il troppo pieno.	1
	Rubinetto Rubinetto miscelatore monocomando monoforo, cromato con bocca girevole.	1

<p>Base sottolavello Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 850 P600 H 890.</p>	1
<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L 850 P350 H 720.</p>	1
<p>Base con ante con piano top in corian Scocca realizzata in nobilitato. Anta in MDF rivestito in tecnopolimero. Ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ergonomiche. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 890.</p>	1
<p>Base con cassetti Struttura dei cassetti in MDF rivestito in tecnopolimero. Top delle basi in corian Priva di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 450 P500 H 900.</p>	1
<p>Piano di lavoro in corian Dimensioni circa mm L 1950</p>	1
<p>Pensile Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero sia a vetro che cieche. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni (per parete libera) mm L 1950 P 350 H 720</p>	1
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P500 H con sopralzo .</p>	1

<p>Armadio farmaci Scocca in nobilitato bilaminato plastico, fondo e fianchi, frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica. Cerniere apertura a 270°. Completo di profilo antipolvere Dotato di serratura con chiave. Dotato di 20 vani sul retro dell'anta e 40 vani interni girevoli dotati di spondine di contenimento dei medicinali in policarbonato trasparente. Dotato di armadietto per stupefacenti munito di serratura antiscasso e anta ribalta Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa Dimensione circa mm L 1000 P 500 H con soprizzo</p>	1
<p>Pensili Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni mm L600 P350 H 720.</p>	3
<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	1
<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1
<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
<p>Pensile Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm max L1200 P350 H 720.</p>	1

DEPOSITO - NEUROLOGIA PESARO	Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P500 H 1800 .	1
CUCINETTA - NEUROLOGIA PESARO	Lavello in acciaio Lavello in acciaio inox 18/10 con due vasche complete di sifone e un gocciolatoio Dimensione circa mm L900 P500.	1
	Rubinetto Rubinetto miscelatore.	1
	Base sottolavello Scocca realizzata in nobilitato. Ante in MDF rivestito in tecnopolimero, predisposizione sottolavello. Internamente vano predisposto come sottolavello con schiena e fondo costruiti per il passaggio delle tubazioni di scarico. Dotata di ripiano regolabile in altezza. Maniglia ergonomica. Priva di spigoli vivi, con bordi perimetrali arrotondati. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra di 150 mm circa. Dimensioni circa mm L900 P600 H 890.	1
	Base con cassetti Realizzata in nobilitato melaminico, con n.4 cassetti con guide metalliche. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.	1
	Base con ante Realizzata in nobilitato melaminico, vano con anta e due ripiani. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 600 P600 H 850.	1
	Piano di cottura Con n. 4 piastre ad induzione. Posizionato su base con ante battenti Dimensioni circa mm L. 1200 P600 H 890	1
	Pensili Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni mm L.600 P350 H 720.	2
	Colonna con frigorifero Frigorifero completo di struttura con capacità di circa 200 lt con piccolo congelatore, con sbrinamento automatico e termostato regolabile a basso consumo energetico. Struttura portante in nobilitato melaminico, con due ante con maniglie, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 600 P P600 H 2000	1

MATERIALE VARIO - NEUROLOGIA PESARO	Carrozzina per trasporto malati Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente. Maniglie di spinta ergonomiche.	1
	Scala doppia con quattro gradini per raggiungere gli armadi e i pensili posti a distanza superiori all'altezza uomo con sponde di sostegno e scalini antisdrucciolo; rispondente alle norme di sicurezza.	1
	Scala A due gradini (per pazienti)	1
	Deambulatore con ascellare	1

FINE ELENCO PER NEUROLOGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE POLIAMBULATO	DESCRIZIONE	Qu.tà
STUDIO CAPOSALA - POLIMABULATO RI PESARO	Carrello porta CPU In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L. 250 P 450 H 170.	2
	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2
	Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.	2
	Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce	1
AMULATORIO 2 NEURO	Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L. 1200 P 800 H 750.	1
	Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.	1

<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.</p>	1
<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1

	<p>Letino da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati . Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
<p>AMBULATORIO 3 GASTROENTERO LOGIA</p>	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. . Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.</p>	1
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1

<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1	
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2	
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1	
<p>Sgabello Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggipiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1	
<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1	
<p>AMBULATORIO 4 PNEUMOLOGIA</p>	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.</p>	1
<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1	
<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.</p>	1	

	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1
	<p>Sgabello Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe 11M di reazione al fuoco. Basamento completo di poggipiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
AMBULATORIO 5 FERITE DIFFICILI	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1

<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.</p>	1
<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1

	<p>Lettino da visita elettrico</p> <p>A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati .</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE</p> <p>Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1
	<p>Sgabello</p> <p>Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas.</p> <p>Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo.</p> <p>Omologato in classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Basamento completo di poggiatesta a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna</p> <p>Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
AMBULATORIO 8 EMG	<p>Sedia dattilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. l.gs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli</p> <p>Imbottita, rivestita in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Portata circa 100 kg.</p>	2

<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1	
<p>Lettino da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati . Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1	
<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1	
<p>Paravento a muro con tenda Paravento con fissaggio a muro orientabile. Asta di scorrimento e supporto tenda in alluminio con movimento telescopico con una uscita massima di 150cm. Tenda in trevira CS.</p>	2	
<p>AMBULATORIO 11 PRE RICOVERO PRELIEVI</p>	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.</p>	2

	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L. 420 P580 H600.</p>	2
	<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L. 260 P 500 H 570.</p>	2
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
AMBULATORIO 12 PRE RICOVERO ANESTESIA	<p>Carrello porta CPU In metallo verniciato su ruote. Dimensioni circa mm L. 250 P 450 H 170.</p>	1
AMBULATORIO 13 NEUROCHIRURGIA	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L. 1200 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L. 1000 P 500 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L. 420 P580 H600.</p>	1

<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 11M di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1
<p>Letto da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati. Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1
<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1

AMBULATORIO 14 UROLOGIA	Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.	1
	Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.	1
	Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L 420 P580 H600.	1
	Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.	1
	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1
	Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.	2
	Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.	1

	<p>Letto da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati . Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L. 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1
	<p>Sgabello Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggipiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
<p>AMBULATORIO 15 CHIRURGIA UROLOGIA</p>	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L. 1400 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L. 1000 P 500 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica . Dotata di nr.3 cassette scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote piroettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L. 420 P580 H600.</p>	1

<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	2
<p>Base con ante con piano top in corian Realizzata in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P 450 H 85.</p>	1

1	<p>Letino da visita elettrico A due sezioni, relai basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati. Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiraleo posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/47/CE Dimensioni circa mm L. 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>
1	<p>Sgaballo Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari proiettanti.</p>
1	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portambracci e vaschetta raccogli gocce</p>
1	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canalina passacavi. Dimensioni circa mm L. 1400 P 800 H 750.</p>
1	<p>Piano dattilo Ergonomico realizzato in corian. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dimensioni circa mm L. 1000 P 500 H 750.</p>
1	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero. Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica. Dotata di nr.3 cassetti scorrevoli su guide metalliche. Basamento su 4 ruote proiettanti con freno. Serratura a chiave centralizzata. Dimensioni circa mm L. 420 P580 H600.</p>

AMBULATORIO
16 CHIRURGIA

<p>Porta CPU Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	1
<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1
<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	2
<p>Armadio per presidi medici Struttura delle ante in MDF rivestito in tecnopolimero. Dotato di maniglie e serratura a chiave. Con n.3 ripiani interni regolabili in altezza. Completo di profilo antipolvere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P500 H 2000.</p>	1
<p>Base con ante con piano top in corian Realizzata in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotata di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1200 P 450 H 85.</p>	1

	<p>Letto da visita elettrico A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato. Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati . Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato. Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati. Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo. Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento. Carico di lavoro sicuro kg 170; Altezza minima cm 57 - massima cm 91. Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato. Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	1
	<p>Sgabello Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggipiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti .</p>	1
	<p>Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce</p>	1
ACCETTAZIONE	BANCONE RECEPTION (per la proposta progettuale/composizione cfr. prospetto allegato)	1
	<p>lato operatore un piano di lavoro profondo almeno 80cm, con altezza di circa 73cm, nel rispetto della normativa vigente (UNI EN 527-1). Tale piano di lavoro sarà schermato da opportuno rialzo dotato superiormente di piano di appoggio per l'utente, ad altezza massima di 100cm.. Inoltre dovrà essere realizzata una parte ribassata ad 80cm per l'accostamento di persona su sedie a ruote, secondo la normativa vigente. Il bancone dovrà essere sagomato in base alle esigenze planimetriche e funzionali. Di seguito si indicano gli elementi di minima che devono essere previsti</p>	
	- Cassettiere con cassetti con chiusura a chiave	
	- Basi con ante a battente chiusura a chiave	
	- accessori (porta cpu; ecc.)	

	<p>I piani dovranno avere spessore di circa mm20-30, e comunque tali o dotati di rinforzi tali da garantirne la resistenza meccanica e la stabilità. Dovranno inoltre essere realizzati con pannelli composti da derivati del legno, con finitura in nobilitato a bassa emissione di formaldeide, antigraffio e antiriflesso. Tutti i bordi dovranno essere arrotondati con raggio di curvatura conforme alla normativa vigente (Dlgs 81/08 e UNI-EN 527-2). I materiali utilizzati dovranno essere a bassa emissione di formaldeide, ed essere omologati in classe 1 di reazione al fuoco. Dovrà essere costituito da elementi tali da poter essere cablati e garantire il passaggio dei cavi all'interno. Il bancone dovrà essere dotato di vetro di chiusura; il vetro dovrà essere del tipo antinfortunistico, e dotato di fessura passacarte e non dovrà ostacolare il dialogo tra operatore ed utente</p>	
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
	<p>Base con ante Realizzata in nobilitato melaminico, vano con anta e due ripiani. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P600 H 850.</p>	1
Postazione di lavoro presso spazio attiguo accettazione	<p>Scrivania Ergonomica realizzata in materiale corian. Con gambe con piedini livellatori e canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	1
	<p>Cassettiera Scocca in nobilitato bilaminato plastico. Schiena e ante frontali, realizzati in MDF rivestito in tecnopolimero Bordi perimetrali arrotondati. Maniglia ergonomica .</p>	1
	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1

ATTESA POLIAMBULATORI PESARO	Seduta su barre Sedute su barra a 2 posti con braccioli. Bracciolo dalla forma ergonomica. Seduta e schienale in materiale plastico con bordi sagomati privi di spigoli Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L 1000 P 600 H 800.	6
	Seduta su barre Sedute su barra a 3 posti con braccioli. Bracciolo dalla forma ergonomica. Seduta e schienale in materiale plastico con bordi sagomati privi di spigoli Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L 1500 P 600 H 800.	28
	Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.	10
MATERIALE VARIO POLIAMBULATORI PESARO	Carrozzina Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente. Maniglie di spinta ergonomiche.	2
	Orologi a muro Con lancette ora e minuti Dimensioni circa mm 250 di diametro	16
SERVIZI IGIENICI 03-06-08-20-22-24	Specchio	6
	Mensola dotata di angoli smussati.	6
	Porta sapone non a rabbocco. Dotato di sistema di erogazione senza contatto. Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	6
	Dispenser asciugamani a rotolo Dotati di sensore per dispensazione senza contatto delle mani, ad erogazione singola Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	6
	Appendiabiti a muro Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Dimensioni circa mm L444 P20 H170.	7
	Porta rotolo cartigenica chiuso. Design sigillato e protetto, (l'utente tocca solo la carta che utilizza) Sistema di erogazione singola Chiuso con serratura per proteggere il rotolo Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	6

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 27-28-29-30	Specchio	5
	Mensola dotata di angoli smussati.	5
	Porta sapone non a rabbocco. Dotato di sistema di erogazione senza contatto. Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	5
	Dispenser asciugamani a rotolo Dotati di sensore per dispensazione senza contatto delle mani, ad erogazione singola Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	5
	Appendiabiti a muro Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti. Angoli arrotondati. Dimensioni circa mm L444 P20 H170.	4
	Porta rotolo cartigienica chiuso. Design sigillato e protetto, (l'utente tocca solo la carta che utilizza) Sistema di erogazione singola Chiuso con serratura per proteggere il rotolo Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	3
LAVANDINI AMBULATORI	Porta sapone non a rabbocco. Dotato di sistema di erogazione senza contatto. Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	16
	Dispenser asciugamani a rotolo Dotati di sensore per dispensazione senza contatto delle mani, ad erogazione singola Facilmente ricaricabile lavabile e disinfettabile.	16

FINE ELENCO PER POLIAMBULATORI PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE - SERVIZI VARI	DESCRIZIONE	Qu.tà
PRONTO SOCCORSO FANO	Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1200 P 800 H 750.	2
	Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.	1

<p>Cassettiera</p> <p>In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa.</p> <p>Con serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento.</p> <p>Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	3
<p>Porta CPU</p> <p>Appeso al piano della scrivania dimensioni circa mm L 260 P 500 H 570.</p>	4
<p>Sedia dattilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 11M di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	4
<p>Sedia interlocutore senza braccioli</p> <p>Imbottita, rivestita in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 11M di reazione al fuoco.</p> <p>Portata circa 100 kg.</p>	4
<p>Armadio libreria</p> <p>Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	1
<p>Seduta su barre N.1</p> <p>Sedute su barra a 3 posti con braccioli.</p> <p>Gambe e braccioli stampati in alluminio pressofuso e cromati, barra in acciaio verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Bracciolo dalla forma ergonomica.</p> <p>Seduta e schienale in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, resistente ai graffi e alla ruggine,</p> <p>con bordo anteriore e posteriore arrotondato e con bordi laterali sagomati e cromati, priva di spigoli vivi.</p> <p>Piedini , puntali in plastica regolabili.</p> <p>Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1770 P 800 H 800.</p>	1

	<p>Lavello in corian con una vasca completa di sifone. Dimensione circa mm L400 P350</p>	1
	<p>Rubinetto Rubinetto miscelatore con leva clinica</p>	1
	<p>Base con ante sottolavello Realizzata in nobilitato melaminico, vano con due ante e predisposizione sottolavello. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P500 H 850.</p>	1
FISICA MEDICA	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2
	<p>Base con ante Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiano interno regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 600 P600 H 850.</p>	1
	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	2
	<p>Cassettiera In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs. Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa. Con serratura a chiave centralizzata. Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento. Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	2

<p>Sedia dattilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
<p>Armadio libreria</p> <p>Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio.</p> <p>Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs</p> <p>Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione.</p> <p>Con maniglie e chiusura a chiave.</p> <p>Ripiani interni regolabili in altezza.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	2
<p>Piano dattilo</p> <p>Ergonomico realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1000 P 500 H 750.</p>	1
<p>Scrivania</p> <p>Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dotata di canaletta passacavi.</p> <p>Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H 750.</p>	1
<p>Cassettiera</p> <p>In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa.</p> <p>Con serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento.</p> <p>Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1

<p>Sedia dattilo Ergonomica antibalzo a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	<p>Sgabelllo Con schienale, girevole e regolabile in altezza mediante molla a gas. Sedile imbottito, rivestito in sky ignifugo. Omologato in classe IIM di reazione al fuoco. Basamento completo di poggiapiedi a 5 razze dotato di nr. 5 ruote gemellari piroettanti.</p>	<p>AMBULATORIO CARDIOLOGIA PESARO Sedia dattilo Ergonomica antibalzo a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	<p>AMBULATORIO CARDIOLOGIA PESARO Sedia interocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	<p>AMBULATORIO CARDIOLOGIA PESARO Attaccapanni a colonna Struttura in acciaio verniciato, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce.</p>	<p>AMBULATORIO MEDICI 5 PIANO FANO Sedia interocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	<p>AMBULATORIO MEDICI 5 PIANO FANO Sedia dattilo Ergonomica antibalzo a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>7</p>	<p>6</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	<p>2</p>

BLOCCO OPERATORIO PESARO	Cassette portaoggetti Realizzate in melaminico con spigoli arrotondati. Con 9 scomparti con ante con chiusura a chiave. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 950 P35 H950.	2
CONTABILITA'	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2
CARDIOLOGIA PESARO	Seduta su barre Sedute su barra a 3 posti con braccioli. Bracciolo dalla forma ergonomica. Seduta e schienale in materiale plastico con bordi sagomati privi di spigoli Sedute conformi al decreto 18.09.02, realizzate completamente con materiali in classe 0 di reazione al fuoco. Dimensioni circa mm L. 1500 P 600 H 800.	4
CUP CASSA (2 per portineria pesaro, 2 per centralino fano)	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	4
DAP FANO	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	1
DMP PESARO	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	2

DERMATOLOGIA FANO	<p>Carrozzina per trasporto malati</p> <p>Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza.</p> <p>Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente.</p> <p>Maniglie di spinta ergonomiche.</p>	1
MURG PESARO	<p>Carrozzina DIMENSIONI RIDOTTE</p> <p>Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza.</p> <p>Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente.</p> <p>Maniglie di spinta ergonomiche.</p>	1
MEDICINA NUCLEARE	<p>Carrozzina</p> <p>Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza.</p> <p>Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente.</p> <p>Maniglie di spinta ergonomiche.</p>	1
MEDICINA RIABILITATIVA PESARO	<p>Scrivania</p> <p>Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs.</p> <p>Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori.</p> <p>Dotata di canaletta passacavi.</p> <p>Dimensioni circa mm L 140 P 800 H 75</p>	1
MEDICINA RIABILITATIVA PESARO	<p>Cassettiera</p> <p>In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Con 3 cassetti, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa.</p> <p>Con serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Con 4 ruote piroettanti con freno, sistema antiribaltamento.</p> <p>Dimensioni circa mm L420 P560 H 580.</p>	1
MEDICINA RIABILITATIVA PESARO	<p>Appendiabiti a muro</p> <p>Su tavoletta con nr.2 ganci porta abiti.</p> <p>Angoli arrotondati.</p> <p>Dimensioni circa mm L444 P20 H170.</p>	1
OCULISTICA FANO	<p>Sedia dattilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe IIM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	1

<p>OCULISTICA FANO</p>	<p>Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	<p>4</p>
<p>OCULISTICA FANO</p>	<p>Sedia interlocutore senza braccioli Imbottita, rivestita in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg.</p>	<p>4</p>
<p>OCULISTICA FANO</p>	<p>Scrivania Ergonomica piano di lavoro realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio con bordo in abs. Gambe in acciaio verniciate a polveri epossidiche con piedini livellatori. Dotata di canaletta passacavi. Dimensioni circa mm L 1400 P 800 H</p>	<p>4</p>
<p>OCULISTICA FANO</p>	<p>Armadio libreria Realizzato in melaminico antiriflesso e antigraffio. Con due ante cieche battenti superiori e due inferiori, con bordi arrotondati in abs Cerniere in metallo e trattamento anticorrosione. Con maniglie e chiusura a chiave. Ripiani interni regolabili in altezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 1000 P 450 H 2000.</p>	<p>2</p>
<p>OCULISTICA FANO</p>	<p>Armadio spogliatoio ad un posto Verniciato con vernici anticorrosione, dotato di un vano con tramezzo verticale sporco/pulito (per contenere in modo distinto abiti civili e divisa) con alla base uno spazio per le calzature, ed in alto un ripiano per riporre oggetti personali. Dotato nel ripiano superiore di asta porta grucce, con portaombrelli e vaschetta raccogli gocce su anta. Con ante a battente e feritoie nella parte superiore e inferiore delle stesse per facilitare l'aerazione. Serratura e doppia chiave e cerniere antiscasso. Porta cartellino su anta. Bordo frontale perimetrale arrotondato e antiurto assenza di parti taglienti e di spigoli vivi. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008. Dimensioni circa mm L 400 P 500 H 1800.</p>	<p>8</p>

ONCOLOGIA FANO	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	4
ORL FANO	Poltrona ORL. meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con escursione di circa 15/20 cm. Schienale regolabile fino a 120° con sistema pneumatico. Seduta ruotabile 360° e provvista di sistema di bloccaggio rotazione. Dotata di poggiatesta, braccioli e poggipiedi. Spessa imbottitura; di materiale facilmente lavabile e disinfettabile (non in tessuto).	4
ORTOPEDIA PESARO	Mobile porta padelle e porta pappagalli per bagni di degenza. A tre posti con dimensioni 65x35x78.	10
PERSONALE	Sedia dattilo Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.	7
PMA	Carrozzina per trasporto malati Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente. Maniglie di spinta ergonomiche.	2

PRERICOVERO FANO	<p>Poltrona ELETTRICA. a tre sezioni con altezza variabile, movimentazione elettrica dello schienale, posizione Trendelenburg, gambale regolabile elettricamente, comandi da pulsantiera con cavo spiralato posta in pozione accessibile al paziente.</p> <p>Piano stampato a tre sezioni sagomato imbottito e rivestito in materiale con proprietà antibatteriche, ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 in classe M1.</p> <p>Coppia poggiaabbraccio stampati, regolabili in altezza, imbottiti, orientabili, ribaltabili e asportabili con dispositivi di bloccaggio. Quattro ruote inossidabili girevoli, diametro circa 120 mm con bloccaggio centralizzato e simultaneo della rotazione e del piroettamento.</p> <p>Telaio in acciaio verniciato a polveri antibatteriche. Dimensioni piano circa cm 185 x 60. Carico di lavoro sicuro almeno 130 Kg.</p> <p>Dispositivo medico conforme 93/42/CEE.</p> <p>Conforme alla normativa di sicurezza vigente in materia.</p>	1
PRONTO SOCCORSO PESARO	<p>Mobiletto metallico.</p> <p>Con 10 scomparti con ante con chiusura a chiave.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L.950 P35 H950.</p>	1
PRONTO SOCCORSO FANO	<p>Carrozzina per trasporto malati</p> <p>Per trasporto pazienti con schienale regolabile, braccioli estraibili, pedane estraibili e regolabili in altezza.</p> <p>Ruote dotate di freno, la dimensione delle ruote deve garantire un facile trasporto del paziente.</p> <p>Maniglie di spinta ergonomiche.</p>	4
PRONTO SOCCORSO FANO	COMODE	2
RIANIMAZIONE FANO	<p>Sedia dattilo</p> <p>Ergonomica antiribaltamento a cinque razze, con ruote e braccioli, altezza del sedile regolabile con elevazione a gas, schienale medio alto regolabile in altezza ed inclinazione, comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, piano del sedile e dello schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura semirigida e rivestimento in sky ignifugo.</p> <p>Omologata in classe 1IM di reazione al fuoco.</p> <p>Con certificazione di conformità al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335.</p>	2
RIANIMAZIONE FANO	<p>Cassette portaoggetti</p> <p>Realizzate in melaminico con spigoli arrotondati.</p> <p>Con 9 scomparti con ante con chiusura a chiave.</p> <p>Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150.</p> <p>Dimensioni circa mm L.950 P35 H950.</p>	1

SERVIZIO INFORMATICO	<p>Cassettiera</p> <p>In materiale melaminico antiriflesso e antigraffio, con bordi arrotondati in abs.</p> <p>Con 3 cassette, dotati di maniglia, scorrevoli su guide con dispositivo di fine corsa.</p> <p>Con serratura a chiave centralizzata.</p> <p>Con 4 ruote piroettanti con freno,</p>	2
URP	<p>Libreria con struttura in tondino di acciaio elettrosaldato verniciato colore Alluminio. Completo di n. 3 ripiani in metallo verniciato colore Alluminio.</p> <p>Dimensioni cm. 100 x 35 x 86h.</p>	5
AMBULATORIO CARDIOLOGIA PESARO	<p>Lettino da visita elettrico</p> <p>A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoformato.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoformato. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati .</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spiralato posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato piedi paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portarotolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I. conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/ 47/CE</p> <p>Dimensioni circa mm L 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>	3

FINE ELENCO PER SERVIZI VARI	
2	<p>TRASFUSIONALE PESARO</p> <p>Letino da visita elettrico</p> <p>A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoplastico.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoplastico. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati.</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spirale posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portatorolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/47/CE</p> <p>Dimensioni circa mm L. 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>
1	<p>AMBULATORIO DERMATOLOGIA FANO</p> <p>Letino da visita elettrico</p> <p>A due sezioni, telaio basamento in acciaio verniciato con carter di copertura centrale in lamiera piegata e coperture delle estremità in abs termoplastico.</p> <p>Colonna di sollevamento con sistema a compassi provvista di carter di protezione in abs termoplastico. Schienale regolabile con pompa a gas, azionabile con apposita leva posta su ambo i lati.</p> <p>Struttura perimetrale dello schienale e del gambale di acciaio verniciato.</p> <p>Movimento di sollevamento comandato da una pulsantiera a 2 tasti con cavo spirale posizionabile da ambo i lati.</p> <p>Piani imbottiti e rivestiti in tessuto, in materiale plastico, lavabile e ignifugo.</p> <p>Basamento dotato di Kit 4 ruote (fisse lato paziente e girevoli lato testa) e di due piedini di bloccaggio con comando a pedale posizionato lato testa paziente da una parte del basamento.</p> <p>Carico di lavoro sicuro kg 170;</p> <p>Altezza minima cm 57 - massima cm 91.</p> <p>Portatorolo realizzato in lega di alluminio inossidabile con supporti in acciaio cromato.</p> <p>Dispositivo medico, in classe I, conforme alla direttiva 93/42 CEE, modificata dalla direttiva 2007/47/CE</p> <p>Dimensioni circa mm L. 1820 P660 H570/910.</p> <p>Garanzia almeno 36 mesi.</p>

LOTTO 3 - ARREDO POSTO LETTO - Importo a base d'asta € 95.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE CHIRURGIA	DESCRIZIONE	Qu.tà
CHIRURGIA - PESARO	<p>"LETTO DEGENZA - Elettrificato, ad altezza variabile dotato di n. 4 ruote direzionali con sistema antistatico e con sistema di frenatura. Piano letto realizzato in ABS a spigoli arrotondati.</p> <p>Struttura dotata di almeno 3 snodi e 4 sezioni di cui 2 retrotraslabili (schienale e gambale) con schienale allungabile. Piano sezioni smontabili per una agevole sanificazione.</p> <p>Comandi elettrici sul letto e pulsantiera per gestire la regolazione delle movimentazioni.</p> <p>Pulsantiera a filo retro illuminata per il paziente.</p> <p>Testiera, pediera rimovibili.</p> <p>Sponde laterali a compasso.</p> <p>Comandi di emergenza CPR facilmente accessibili su entrambi i lati del letto, anche in assenza di alimentazione.</p> <p>Carico di lavoro di sicurezza non inferiore a 250 kg.</p> <p>Movimento elettrico Trendelenburg e Contro Trendelenburg da 0° al almeno +/- 12°.</p> <p>Altezza del letto variabile elettricamente indicativamente fino a 700 mm.</p> <p>Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>Piano rete, spalle e sponde con protezione antibatterica integrata al materiale.</p> <p>Tutte le superfici del letto devono essere in materiale resistente ai prodotti per la pulizia.</p> <p>Predisposizione per l'inserimento di accessori: asta flebo e pompe infusione sia nel lato.</p> <p>Batteria per movimentare il letto in caso di assenza di rete elettrica.</p> <p>Conforme alla norma tecnica UNI CEI EN 60601-2-52.</p> <p>Grado di protezione IP 66. Garanzia almeno 36 mesi.</p>	33
	<p>Asta solleva malati</p> <p>Realizzata in tubo di acciaio.</p> <p>Completa cinghia regolabile in altezza e maniglione di sollevamento in materiale plastico.</p>	33
	<p>Asta flebo con ganci</p> <p>Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza.</p>	33
	<p>Piantane porta pompe infusione</p> <p>Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote</p>	4
	<p>Piantane porta flebo</p> <p>Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote</p>	10
	<p>Porta sacche urine in acciaio inox.</p>	33

<p>Comodino bifronte Realizzato in tecnopolimero antibatterico, scocca in unico blocco con portabottiglie, circa cm 50 x 43 x 81, piano superiore con bordi di contenimento stampato, cassetto monoblocco asportabile con divisorio, anta girevole su cerniere, archetto porta salviette laterale, piano servitore incorporato regolabile in altezza, allungabile e inclinabile a leggio, completo di quattro ruote girevoli con paracolpi di diametro 50 mm circa.</p>	33
<p>Armadio a due posti Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 900 P 500 H 1900.</p>	15
<p>Armadio a un posto Scocca realizzata in nobilitato, spessore minimo 18 mm circa. Dotato di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Ante a battente con bordi arrotondati, realizzate in MDF o tecnopolimero spessore minimo 18 mm circa. Cerniere in grado di garantire un'apertura di almeno 110°. Serratura con chiave in ogni anta. Maniglia ergonomica. Internamente dotato di asta appendiabiti in acciaio verniciato, nella parte superiore; di ripiani e di un cassetto estraibile nella parte inferiore. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L 450 P 500 H 1900.</p>	3
<p>Sedia su gambe senza braccioli Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.</p>	18
<p>Sedia su gambe con braccioli Scocca seduta, schienale e braccioli realizzata in polipropilene. Omologata in classe IIM di reazione al fuoco. Portata circa 100 kg. Dimensioni circa mm L590 P540 H820.</p>	15

<p>Poltrona relax per pazienti Schienale e gambale regolabili con comando a gas sincronizzato facilmente raggiungibile Reclinabile fino a raggiungere la posizione distesa Pedana poggipiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta , a scomparsa dietro il gambale quando chiusa Braccioli imbottiti e abbattibili N. 4 ruote diametro circa 125 mm di cui due bloccabili Maniglione di spinta Tavolino termoformato abbattibile Porta sacca Asta flebo con due ganci in acciaio Rivestimento della poltrona in similpelle ignifugo in classe 1/IM Ingombro posizione eretta: circa cm 74x90x127h Ingombro posizione distesa: circa cm 74x170x73h Larghezza sedile: circa cm 51 Altezza sedile da terra: circa cm 52 Portata: almeno kg 120 Rispondente alle normative di sicurezza vigenti in materia</p>		10
	<p>Tavolino Dimensioni circa mm L900 P550 H780</p>	10

FINE ELENCO PER CHIRURGIA PESARO

SERVIZI RICHIEDENTI - VARI	DESCRIZIONE	Qu.tà
CARDIOLOGIA FANO	<p>Poltrona relax per pazienti Schienale e gambale regolabili con comando a gas sincronizzato facilmente raggiungibile Reclinabile fino a raggiungere la posizione distesa Pedana poggipiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta , a scomparsa dietro il gambale quando chiusa Braccioli imbottiti e abbattibili N. 4 ruote diametro circa 125 mm di cui due bloccabili Maniglione di spinta Tavolino termoformato abbattibile Porta sacca Asta flebo con due ganci in acciaio Rivestimento della poltrona in similpelle ignifugo in classe 1/IM Ingombro posizione eretta: circa cm 74x90x127h Ingombro posizione distesa: circa cm 74x170x73h Larghezza sedile: circa cm 51 Altezza sedile da terra: circa cm 52 Portata: almeno kg 120 Rispondente alle normative di sicurezza vigenti in materia</p>	8

	Poltrona relax per pazienti Schienale e gambale regolabili con comando a gas sincronizzato facilmente raggiungibile Reclinabile fino a raggiungere la posizione distesa Pedana poggipiedi in materiale plastico, estraibile a ribalta, a scomparsa dietro il gambale quando chiusa Braccioli imbottiti e abbattibili N. 4 ruote diametro circa 125 mm di cui due bloccabili Maniglione di spinta Tavolino termoformato abbattibile Porta sacca Asta flebo con due ganci in acciaio Rivestimento della poltrona in similpelle ignifugo in classe 1/IM Ingombro posizione eretta: circa cm 74x90x127h Ingombro posizione distesa: circa cm 74x170x73h Larghezza sedile: circa cm 51 Altezza sedile da terra: circa cm 52 Portata: almeno kg 120 Rispondente alle normative di sicurezza vigenti in materia	8
UROLOGIA PESARO	ASTA FLEDO CON GANCI Realizzata in acciaio inox con almeno due ganci, regolabile in altezza.	15
NEUROLOGIA PESARO	Piantane porta pompe infusione Realizzata in tubo di acciaio cromato telescopico con ruote	5
FINE ELENCO PER SERVIZI VARI		

LOTTO 4 - CARRELLI - Importo a base d'asta € 25.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
ANATOMIA PATOLOGICA	Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800. 1	4
FINE ELENCO PER ANATOMIA PATOLOGICA		
SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà

CHIRURGIA PESARO	<p>Carrello per terapia endovenosa/orale Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Nr.4 cassette con colori e altezze diverse. Scocca con una pattumiera su un lato. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti, contenitore taglienti. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassettei. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	<p>2</p>
	<p>Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, o materiale migliorativo. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita. Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita. Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all'ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene. Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti. Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.</p>	<p>1</p>
	<p>Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800.</p>	<p>2</p>

Carrello per emergenza

Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico.

Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.

Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.

Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati.

Piano di appoggio estraibile lateralmente.

Scocca con una pattumiera su un lato.

N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sondini, supporto contenitore taglienti.

N. 4 cassetti con altezze diverse con chiusura a chiave e con sgilli di garanzia SG.

Piattaforma per defibrillatore. Asta portaflebo regolabile in altezza con due ganci.

Sopralzo alto sul piano di appoggio con:

N. 9 distributori trasparenti disposte su due file.

N. 1 distributore universale per disinfettante.

N. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno.

Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.

Gruppo prese multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato.

Dimensioni circa mm L. 900 P600 H1000.

3

FINE ELENCO PER CHIRURGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
NEUROLOGIA - PESARO	<p>Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria</p> <p>Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche, o materiale migliorativo.</p> <p>Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia.</p> <p>Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita.</p> <p>Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita.</p> <p>Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all'ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene.</p> <p>Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori.</p> <p>Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti.</p> <p>Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.</p> <p>Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica.</p>	1

<p>Carrello universale In acciaio inox. Ripiani n. 2 amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Portata minima per piano kg 25 Dimensioni circa mm L 840 P540 H800. 1</p>	1
<p>Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassette con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N. 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassettei. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	1

FINE ELENCO PER NEUROLOGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
<p>POLIAMBULATORI PESARO</p>	<p>Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassette con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N. 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassettei. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	6

<p>Carrello universale In acciaio inox. Ripiani amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Dimensioni circa mm L 600 P400 H800.</p>	2
--	---

FINE ELENCO PER POLIAMBULATORI PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
<p>DERMATOLOGIA AMBULATORIO FANO</p>	<p>Carrello emergenza Struttura realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sondini, supporto contenitore taglienti. N. 4 cassette con altezze diverse con chiusura a chiave e con sgilli di garanzia SG. Piattaforma per defibrillatore. Asta portaflebo regolabile in altezza con due ganci. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N. 9 distributori trasparenti disposte su due file. N. 1 distributore universale per disinfettante. N. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Gruppo prese multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	1
<p>MEDICINA 1 e 2 FANO</p>	<p>Carrello per terapia endovenosa/orale Struttura monoscocca in polietilene. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Nr.4 cassette con colori e altezze diverse. Scocca con una pattumiera su un lato. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti, contenitore taglienti. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L. 900 P600 H1000.</p>	3

MEDICINA NUCLEARE	Carrello universale In acciaio inox. Ripiani amovibili in lamiera di acciaio. Maniglione in tubo tondo di acciaio inox. Alla base 4 ruote diametro 125 mm con freno. Dimensioni circa mm L 600 P400 H800.	2
ONCOLOGIA FANO	Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassette con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N. 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.	2
FINE ELENCO PER SERVIZI VARI PESARO		

LOTTO 5 - BARELLE - Importo a base d'asta € 12.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
---------------------------------	--------------------	--------------

CHIRURGIA - PESARO	<p>Barella</p> <p>Per trasporto pazienti ad altezza variabile oleodinamica in materiale plastico P.P. Piano rete con tre sezioni, non radiotrasparente, con alzatesta regolato mediante pompa a gas Sponde laterali a compasso, abbattibili, con ampia protezione laterale per una maggiore sicurezza del paziente. Sezione schienale inclinabile con controllo pneumatico servoassistito. Movimento Trendelenburg e anti Trendelemburg. Paracolpi lungo l'intero perimetro. Maniglione di spinta ergonomico. Ruote da 8" (20,32 cm) con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale. Alloggiamento per asta porta flebo (perimetrale) sui 4 angoli. Asta portaflebo telescopica integrata -HEAD. Porta bombola per ossigeno con fissaggio rispondente alla normativa vigente. Ampio vano porta oggetti. Cinghie di contenimento. Piano di appoggio multifunzione. Controlli idraulici con triplo pedale su entrambi i lati. Materasso ignifugo, antistatico, antibatterico e facilmente sanificabile. Carico di lavoro sicuro uguale o superiore ai 250 kg.</p>	<p>1</p>
---------------------------	---	----------

FINE ELENCO PER CHIRURGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
POLIAMBULATORI	<p>Barella</p> <p>Per trasporto pazienti ad altezza variabile oleodinamica in materiale plastico P.P. Piano rete con tre sezioni, non radiotrasparente, con alzatesta regolato mediante pompa a gas Sponde laterali a compasso, abbattibili, con ampia protezione laterale per una maggiore sicurezza del paziente. Sezione schienale inclinabile con controllo pneumatico servoassistito. Movimento Trendelenburg e anti Trendelemburg. Paracolpi lungo l'intero perimetro. Maniglione di spinta ergonomico. Ruote da 8" (20,32 cm) con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale. Alloggiamento per asta porta flebo (perimetrale) sui 4 angoli. Asta portaflebo telescopica integrata -HEAD. Porta bombola per ossigeno con fissaggio rispondente alla normativa vigente. Ampio vano porta oggetti. Cinghie di contenimento. Piano di appoggio multifunzione. Controlli idraulici con triplo pedale su entrambi i lati. Materasso ignifugo, antistatico, antibatterico e facilmente sanificabile. Carico di lavoro sicuro uguale o superiore ai 250 kg.</p>	<p>1</p>

FINE ELENCO POLIAMBULATORI PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
PRERICOVERO FANO	<p>Barella</p> <p>Per trasporto pazienti ad altezza variabile oleodinamica in materiale plastico P.P.</p> <p>Piano rete con tre sezioni, non radiotrasparente, con alzatesta regolato mediante pompa a gas</p> <p>Sponde laterali a compasso, abbattibili, con ampia protezione laterale per una maggiore sicurezza del paziente.</p> <p>Sezione schienale inclinabile con controllo pneumatico servoassistito.</p> <p>Movimento Trendelenburg e anti Trendelenburg.</p> <p>Paracolpi lungo l'intero perimetro.</p> <p>Maniglione di spinta ergonomico.</p> <p>Ruote da 8" (20,32 cm) con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale.</p> <p>Alloggiamento per asta porta flebo (perimetrale) sui 4 angoli.</p> <p>Asta portaflebo telescopica integrata –HEAD.</p> <p>Porta bombola per ossigeno con fissaggio rispondente alla normativa vigente.</p> <p>Ampio vano porta oggetti.</p> <p>Cinghie di contenimento.</p> <p>Piano di appoggio multifunzione.</p> <p>Controlli idraulici con triplo pedale su entrambi i lati.</p> <p>Materasso ignifugo, antistatico, antibatterico e facilmente sanificabile.</p> <p>Carico di lavoro sicuro uguale o superiore ai 250 kg.</p>	1
PRONTO SOCCORSO FANO	<p>Barella</p> <p>Per trasporto pazienti ad altezza variabile oleodinamica in materiale plastico P.P.</p> <p>Piano rete con tre sezioni, non radiotrasparente, con alzatesta regolato mediante pompa a gas</p> <p>Sponde laterali a compasso, abbattibili, con ampia protezione laterale per una maggiore sicurezza del paziente.</p> <p>Sezione schienale inclinabile con controllo pneumatico servoassistito.</p> <p>Movimento Trendelenburg e anti Trendelenburg.</p> <p>Paracolpi lungo l'intero perimetro.</p> <p>Maniglione di spinta ergonomico.</p> <p>Ruote da 8" (20,32 cm) con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale.</p> <p>Alloggiamento per asta porta flebo (perimetrale) sui 4 angoli.</p> <p>Asta portaflebo telescopica integrata –HEAD.</p> <p>Porta bombola per ossigeno con fissaggio rispondente alla normativa vigente.</p> <p>Ampio vano porta oggetti.</p> <p>Cinghie di contenimento.</p> <p>Piano di appoggio multifunzione.</p> <p>Controlli idraulici con triplo pedale su entrambi i lati.</p> <p>Materasso ignifugo, antistatico, antibatterico e facilmente sanificabile.</p> <p>Carico di lavoro sicuro uguale o superiore ai 250 kg.</p>	5

LOTTO 6 - ARREDO ACCIAIO/LAMIERA - Importo a base d'asta € 32.000,00 Iva esclusa

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
DEPOSITO 06 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Rialzata da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 1200 P 400 H 2000</p>	1
DEPOSITO PEZZI 10 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Rialzata da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 1200 P 400 H 2000</p>	1
SEGRETERIA ACCETTAZIONE 13 - ANATOMIA PATOLOGICA	<p>Base 1 Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L 1500 P500 H 750</p>	1
	<p>Base 1 Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L 900 P500 H 750</p>	1
	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L mm 1800 P450 H 2000.</p>	1

1	<p>Rubinetto N. 1 Rubinetto miscelatore</p>	<p>ANATOMIA PATOLOGICA</p>
1	<p>Bancone lavello Lavello in acciaio inox AISI con una vasca dimensione mm circa L.600 P.400 con alzataina posteriore e gocciolatoio a destra. Con ante scorrevoli. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L.1200 P.600 H.800.</p>	<p>LAVAGGIO 28 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>
2	<p>Base Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L.900 P.500 H.750</p>	<p>UFFICIO 25 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>
2	<p>Base Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L.900 P.500 H.750</p>	<p>UFFICIO 23 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>
1	<p>Base Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L.1500 P.500 H.750</p>	<p>UFFICIO DIRETTIVO - 20 ANATOMIA PATOLOGICA</p>
1	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzata da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L.1200 P.400 H.2000</p>	<p>DEPOSITO 16 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>
1	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzata da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L.1200 P.400 H.2000</p>	<p>TECNICO 15 - ANATOMIA PATOLOGICA</p>

FINE ELENCO PER ANATOMIA PATOLOGICA		SERVIZIO	DESCRIZIONE	RICHIEDENTE	Quota
1	Pensile 1 - APB 126 - Realizzato in nobilitato melaminico. Vano con due ante e due ripiani. Dimensioni circa mm L.1200 P350 H 720.				
1	Tavolo lavoro su ruote Struttura portante in alluminio e acciaio inox. Ruote gemellari dotate di freno. Paracolpi posteriori. Piano in cortan profondità circa mm 600. Dimensioni circa mm L.1600 P615 H780.				
1	Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. mm 1400 P450 H 2000.	DEPOSITO - PULITO - CHIRURGIA	Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L. mm 1500 P700 H 2085.		
2	DEPOSITO BIANCHERIA - CHIRURGIA	Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L. mm 1500 P700 H 2085.	Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoisolanti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L. mm 1500 P700 H 2085.		

DEPOSITO CONVIVENZA - CHIRURGIA	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere , ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala scorrevole, rispondente alla normativa vigente in sicurezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L. mm 1500 P700 H 2085.</p>	2
--	---	----------

FINE ELENCO PER CHIRURGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
CAPOSALA NEUROLOGIA	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala scorrevole Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 1800 P450 H 2000</p>	1
GUARDIOLA INFERMIERI NEUROLOGIA	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L. 1400 P450 H 1800</p>	1
DEPOSITO - NEUROLOGIA	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Facilmente lavabile e disinfettabile Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L. 1000 P 400 H 2000</p>	

<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere , ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L per tutta la parete mm 3000 P450 H a soffitto.</p>	1
---	---

FINE ELENCO PER NEUROLOGIA PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
LOCALE 25 RICONDIZIONAMENTO FERRI - POLIAMBULATORI	<p>Bancone lavello Lavello in acciaio inox AISI con una vasca dimensione mm circa L600 P 400 con alzatina posteriore e gocciolatoio a destra. Con ante scorrevoli. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm circa L 1600 P 600 H 800.</p>	1
	<p>Rubinetto Rubinetto miscelatore con leva clinica lunga</p>	1
	<p>Scaffalatura In acciaio inox, con ripiani regolabili in altezza Rialzato da terra di 150 mm circa Dimensioni circa mm L 1000 P 350 H 2000</p>	1
ACCETTAZIONE POLIMABULATORI	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere , ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni circa mm L mm 1600 P450 H 2000.</p>	4

	<p>Carrello servitore Struttura in acciaio inox 18/10 (AISI 304) con regolazione in altezza mediante pompa oleodinamica a circuito chiuso con movimento a pedale. Piano di lavoro ad invaso estraibile e sterilizzabile. Basamento inossidabile a 4 razze con ruote antistatiche inossidabili antitraccia di cui due bloccabili, dotato di 4 paracolpi perimetrali. Carico di lavoro per piano Kg 50.. Rispondente alla normativa di sicurezza vigente in materia. Dimensioni indicative: lunghezza cm. 60, profondità cm 40, altezza cm 90.</p>	4
--	---	---

FINE ELENCO PER POLIAMBULATORI PESARO PESARO

SERVIZIO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE	Qu.tà
DIALISI FANO	<p>Classificatore con 4 cassette Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni circa mm L 500 P650 H 1400</p>	2
MALATTIE INFETTIVE	<p>Classificatore con 4 cassette Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dimensioni circa mm L 500 P650 H 1400</p>	2
MEDICINA COMPETENTE FANO	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala scorrevole, rispondente alla normativa vigente in sicurezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L mm 1200 P700 H 1800.</p>	2
MEDICINA COMPETENTE FANO	<p>Armadio in metallo con ante scorrevoli + sopralzo (h. 700) Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere, ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala scorrevole, rispondente alla normativa vigente in sicurezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L mm 1500 P700 H 1800.</p>	1

POLO ENDOSCOPICO FANO	Armadio in metallo con ante scorrevoli Struttura interamente realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura con chiave, internamente n.4 ripiani regolabili su cremagliere , ogni ripiano deve sostenere almeno kg 120 Privo di spigoli vivi, con bordi arrotondati. Dotato di scala scorrevole, rispondente alla normativa vigente in sicurezza. Dotato di piedini regolabili, rialzato da terra mm circa 150. Dimensioni mm L. mm 1500 P700 H 2400.	1
POLO ENDOSCOPICO FANO	Armadio su ruote per zoccoli In acciaio inox AISI 304 – EN 1.4301. Due ante a battente con guarnizione in gomma a perfetta tenuta antipolvere. Finitura scotch Brite. Chiusura con serratura. Cinque ripiani interni regolabili. Base su 4 ruote piroettan	2

FINE ELENCO PER SERVIZI VARI

Schema di ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE

Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/36634340-41, fax 0721/366336. **Oggetto della gara:** procedura aperta per la fornitura, in lotti distinti, di arredi per le varie UU.OO. di questa Azienda La fornitura è articolata in n. 5 lotti unici non frazionabili. Lotto 1 Cig: 6971235D19; Lotto 2 Cig: 697125097B; Lotto 3 Cig: 6971286731; Lotto 4 Cig: 6971293CF6; Lotto 5 Cig: 6971296F6F. **Quantitativo o entità totale:** l'importo complessivo è pari ad € 793.000,00 Iva esclusa. Verranno escluse offerte superiori agli importi fissati a base d'asta, come meglio specificato nel disciplinare di gara. **Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa come meglio specificato nel disciplinare di gara. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida. **Termine e luogo presentazione offerte:** entro e non oltre le ore 11:00 del _____ al Protocollo della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica di questa Azienda Viale Trieste 391 (secondo piano) – 61121 Pesaro, pena l'esclusione. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione di gara disponibile sul sito www.ospedalimarchenord.it. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E: _____; Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Stefanini Pesaro, li _____.



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

All. n. 7 - SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
(la Stazione Appaltante – prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche NON SOSTANZIALI al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il progetto presentato dall'aggiudicatario)

Contratto per la fornitura la fornitura, in lotti distinti, di arredi per la varie UU.OO di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

Lotto 1 - CIG: _____.

Lotto 2 - CIG: _____.

Lotto 3 - CIG: _____.

Lotto 4 - CIG: _____.

Lotto 5 - CIG: _____.

L'anno _____ il giorno _____ (_____), del mese di _____,

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Stazione Appaltante", con sede legale in Pesaro, viale Trieste, 391, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ssa Maria Capalbo, nato a _____ (_____) il _____, residente a _____, V. _____, n° _____, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

la Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di _____, dal Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, residente a _____ Via _____ n. _____ (carta d'identità n° _____ e come risulta dalla procura speciale), in seguito denominata "appaltatore"

PREMESSO:

- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° _____ del _____ è stata avviata la procedura aperta per _____, Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" n° _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta _____ per un importo complessivo netto di € _____ (pari ad € _____ IVA inclusa), articolato come segue: _____ (inserire gli importi delle varie prestazioni oggetto del contratto);
- che in data _____ è stata data comunicazione ai controinteressati;
- che è stato pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- che l'esecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Stazione Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con garanzia bancaria/assicurativa n° _____ dell' _____ per l'importo di Euro _____ (eventuale: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'appaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.90 del D.Lgs 50/2016; qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'appaltatore di obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata);
- che l'esecutore ha presentato copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. _____;
- che l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata;
- che l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri dell'esecutore;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. verbale di aggiudicazione;
4. disciplinare di gara e relativi allegati;
5. capitolato speciale, capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
6. offerta tecnica dell'esecutore;
7. offerta economica dell'esecutore;
8. cauzione definitiva;
9. polizza assicurativa per responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- presente atto
- disciplinare di gara
- elaborati tecnico-economici¹.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010 (se ed in quanto applicabile) nonché dalle disposizioni delle Linee Guida ANAC e dei DPCM che, in corso di esecuzione dal presente contratto, verranno adottati ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro);
2. esecutore, la ditta _____;
3. offerta affidataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico del procedimento, la dott.ssa Chiara D'Eusanio;
5. direttore dell'esecuzione, il Dott. _____ con qualifica di Direttore della UOC _____.

L'esecutore individua:

- nel Dott. _____ il Responsabile tecnico della fornitura (cfr. art. ____ del capitolato speciale) al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo.

Il corrispettivo del presente atto, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro _____ + iva, di cui Euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dell'offerta economica dell'esecutore come di seguito riepilogato:

(riportare prospetto riepilogativo offerta economica)

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'esecutore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo è comprensivo della realizzazione degli impianti e dei servizi come previsto dal capitolato speciale, dal capitolato tecnico e relativi allegati e dall'offerta tecnica dell'esecutore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Opzione d'acquisto ai sensi dell'art. 1331 c.c.

Questa Azienda procederà all'aggiudicazione definitiva degli arredi dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico per le quantità ivi indicate riservandosi sin d'ora di procedere, entro 24 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all'acquisto dall'operatore economico aggiudicatario, di ulteriori quantitativi di arredi con caratteristiche identiche a quelle dei prodotti aggiudicati per un importo massimo pari al valore sopra indicato quale "opzione d'acquisto" (*gr. Tabella 1, col. B*).

In tale ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire gli ulteriori quantitativi di arredi alle stesse condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente capitolato speciale.

Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà di questa Azienda di procedere alla variante dei contratti qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010 smi.

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione

L'esecuzione del presente atto deve avvenire presso la UOC di _____ sita presso il Presidio Ospedaliero di _____, V. _____ -- Pesaro.

ARTICOLO 5 - Sopralluogo

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria effettuare, prima della messa in produzione degli arredi, il sopralluogo delle sedi e dei locali di destinazione al fine di:

- rilevare le misure esatte degli spazi disponibili;
- concordare con le rispettive Coordinatrici Infermieristiche di reparto i colori degli arredi da fornire.

Non si assumono pertanto responsabilità per eventuali criticità si riscontrassero all'atto dell'installazione degli arredi.

Ogni onere di cui sopra e di quant'altro precisato in seguito deve essere ricompreso nel prezzo contrattuale richiamando l'impresa aggiudicataria a quanto previsto dal successivo art. 4 - Servizio di Consegna e Installazione.

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura e servizi accessori oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della SA.

L'Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie (comprese le opere edili ed impiantistiche) per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, da svolgersi presso le sedi operative della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore prende atto ed accetta che la fornitura ed i relativi servizi del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto,

gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati nel presente atto;
- c) all'installazione della fornitura nei luoghi di destinazione degli arredi come indicati nel capitolato speciale";
- d) allo sgombero, alla pulizia e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e gli adempimenti di cui al verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 9 - Garanzie

Generalità

L'esecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'esecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

La stazione appaltante e l'esecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla data di approvazione degli atti di **collaudo** secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'esecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'articolo 1456 c.c..

Manutenzione in garanzia

L'impresa aggiudicataria si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita in garanzia minimo pari a 36 mesi ovvero per il maggior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura formalizzata mediante sottoscrizione del verbale di collaudo/attestazione di regolare esecuzione di cui all'art 6 del presente capitolato speciale. La garanzia post-vendita comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa

l'eventuale sostituzione dei pezzi di ricambio.

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore ha costituito la cauzione definitiva richiamata in premessa.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione appaltante a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto, consegna della fornitura e relativo collaudo.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà all'aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il servizio di consegna e allestimento è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere e spesa inerenti l'imballaggio, il trasporto al piano, l'assemblaggio e l'installazione a regola d'arte.

Gli arredi dovranno essere consegnati, assemblati, installati e pronti all'uso entro e non oltre **40 (quaranta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine.**

Questa Azienda si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 del art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

I prodotti devono essere imballati in maniera adeguata a prevenire qualunque danneggiamento degli stessi durante il trasporto e le fasi successive pertanto le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'impresa aggiudicataria.

Gli arredi devono essere consegnati e montati, completi in ogni parte, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria nelle seguenti sedi dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord:

- UOC Anatomia Patologica – P.O. San Salvatore – Pad. I – Primo livello;
- Poliambulatori – P.O. San Salvatore – Pad. I – Secondo livello;
- U.O.C Chirurgia - P.O. San Salvatore di Pesaro – Pad. A – Primo piano;
- U.O.C. Neurologia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. H – Primo piano;
- U.O.C Ortopedia – P.O. San Salvatore Pesaro – Pad. B Secondo piano;
- Servizi vari (varie sedi aziendali Pesaro/Fano).

E' obbligo dell'impresa aggiudicataria dare preventiva comunicazione scritta ai referenti delle rispettive UU.OO. che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura, al RUP ed al DEC, del programma di installazione degli arredi in modo da consentire il coordinamento con le esigenze dei vari servizi sanitari e/o con la tempistica dei lavori.

Collaudo

Si richiama integralmente l'art. 7 del capitolato speciale.

Condotte a termine le operazioni previste dall'art. 6 del capitolato speciale, l'organo di collaudo trasmette al

R.U.P. i documenti acquisiti ed il certificato di collaudo emesso.

La stazione appaltante potrà procedere all'approvazione del certificato di collaudo con apposito atto da emanarsi entro 30 giorni.

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo

Si rinvia integralmente all'art. 11 del capitolato speciale.

Inoltre si precisa quanto segue.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto *dell'assistente contabile e dell'assistente tecnico*, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della Legge n. 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'esecutore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - Subappalto

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate:

➤ _____

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'esecutore ha depositato presso la stazione appaltante la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di subappalto prevede all'art. 18 la clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

La stazione appaltante autorizzerà il subappalto a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subesecutore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subesecutore.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subesecutore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'esecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 13 - Penali

I RUP – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti come segue:

(l'impresa aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte della S.A)

Parametro di valutazione	Penale	Modalità di applicazione
Termine per l'ultimazione dell'installazione (art. 4 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura mancante	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per la sostituzione di arredi e complementi d'arredo non conformi (art. 5 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura da sostituire	Per ogni giorno solare di ritardo
Termine per l'effettuazione dell'intervento di assistenza post-vendita: riparazione/sostituzione (art. 8 del presente capitolato)	1% del valore contrattuale della fornitura oggetto dell'intervento	Per ogni ora solare di ritardo nell'intervento. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e installazione di arredo sostituito.
In caso del verificarsi di n. 3 identici eventi sulla medesima tipologia di arredo/componenti	1% del valore contrattuale	

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento di comunicazione della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accettabili dalla SA, ovvero pervengano in ritardo rispetto al termine sopra indicato, saranno applicate al fornitore le relative penali a decorrere dall'inadempimento.

L'applicazione delle penali previste da presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Rimane fermo comunque per la SA il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno dell'aggiudicatario qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti. Resta a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante alla SA a causa dell'inadempienza; la ditta inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Questa SA si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale riterrà opportuno.

Esecuzione in danno: Qualora l'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la SA potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'impresa aggiudicataria, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla SA.

Per il risarcimento dei danni, la SA potrà rivalersi, mediante trattative sugli eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Art. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
- cessione del contratto;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- violazione del patto di integrità;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ritardi superiori a 20 giorni rispetto ai tempi di consegna e installazione previsti dall'art. 4 del presente capitolato;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto (es. verifica di conformità con esito negativo, penali applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; ecc).

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la ditta consegna prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
- la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo della fornitura;

➤ la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Per le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 - Recesso

Visto e richiamato integralmente l'art. 15 del capitolato speciale, si conviene, in ogni caso, che la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'esecutore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a

copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. . In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

In caso di forniture, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'esecutore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno,

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'esecutore e della ditta subentrante.

L'esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art. 13 del Capitolato d'oneri in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'esecutore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti,

incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ARTICOLO 20 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro.

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 17 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera
" _____ "
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. _____

L'esecutore
Il _____
Sig. _____

Il R.U.P.
Dott. _____

Il sottoscritto Sig. _____, in qualità di _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le

condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 5 – Sopralluogo

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Articolo 9 - Garanzie

Articolo 10 – Avvio esecuzione del contratto, consegna e collaudo

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 13 - Penali

Articolo 14 - Risoluzione

Articolo 15 – Recesso

Pesaro, li _____

L'esecutore
Il _____
Sig. _____



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord”
SEDE LEGALE: p.le Cinelli, 4
61121 PESARO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

Committente:

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”

Oggetto:

**Fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di arredi
vari per varie Unità Operative dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord”**

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del capitolato d'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Pertanto questa versione preliminare del D.U.V.R.I. dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, attrezzature utilizzate, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

Il D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritto ed allegato al contratto che verrà stipulato con la ditta Aggiudicataria.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

1. FIGURE DI RIFERIMENTO

Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"			
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dr.ssa Maria Capalbo	p.le Cinelli - Pesaro	0721 - 366304
Responsabile Unico del Procedimento/ U.O.C. Approvvigionamenti Beni e Servizi	Dott.ssa Assunta Pedini	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 - 366340
Direttore Esecuzione del contratto	Da definire		
Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Pesaro	Dr. Giovanni Tassinari	p.le Cinelli - Pesaro	0721 / 366447
Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Fano	Dr.ssa Luana Stefanelli	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 - 882522
Coordinatrice Direzione Media Presidio Fano	Coord. M.Stella Baldelli	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 - 882522
Coordinatrice Servizio Igiene Ospedaliera	Dott.ssa Patrizia Lobati	p.le Cinelli - Pesaro	0721 / 366426
Coordinatore Medici Competenti	Dott. Nicola Nardella	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 - 882522
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott. ssa Monica Bono	Via Lombroso, 1 - Pesaro	0721 - 364162
Coordinatore Servizio Officina	Sig. Gianluca Rossi	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721- 362395 0721 / 882219

2. DITTA APPALTATRICE *

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

*) campi da compilare a seguito di aggiudicazione dell'appalto

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende affidare la fornitura di arredi vari, per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

La fornitura è suddivisa in n. 4 lotti distinti:

- LOTTO 1 Arredo in acciaio
- LOTTO 2 Arredo sanitario
- LOTTO 3 Carrelli
- LOTTO 4 Arredo posto letto, - letti visita e barelle

Gli arredi sono destinati ai seguenti reparti e servizi:

- U.O.C. Anatomia Patologica P.O. San Salvatore di Pesaro
- U.O.C. Oncologia - P.O. San Salvatore di Pesaro – Stab. Muraglia
- U.O.C. Chirurgia – P.O. San Salvatore Pesaro –
- Poliambulatori – P.O. San Salvatore Pesaro -

La fornitura prevede le seguenti attività a carico della Ditta Aggiudicataria :

- trasporto e consegna nelle sedi di destinazione degli arredi;
- assemblaggio, installazione e posa in opera a regola d'arte;
- il ritiro degli imballaggi o del materiale di scarto;

3.1 - DURATA DEI LAVORI:

La durata del servizio dipende dai tempi di consegna e di installazione di tutti gli arredi e attrezzature ordinati.

3.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

Gli orari e le modalità di accesso sono concordati con il Direttore di Esecuzione del contratto o suo delegato, in accordo con i Direttori/ Coordinatori delle varie UU.OO.CC. di destinazione degli arredi.

3.3 - LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE:

In accordo con il Direttore di Esecuzione del contratto potranno essere predisposte aree per carico, scarico e trasporto di attrezzature e materiali, che dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate al fine di interdire l'accesso alle persone non autorizzate.

3.4 - NUMERO DI LAVORATORI:

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio del servizio. Il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3.5 - INFORTUNI

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il rispettivo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pesaro o di Fano, dovranno poi rivolgersi al proprio Medico Competente per la gestione dell'infortunio, per gli eventuali trattamenti profilattici, per i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

3.6 SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITÀ RELATIVE:

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Se necessario ed autorizzato, l'Appaltatore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti per l'Appaltatore nel presente contratto.

4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno "Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture".

Il Documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati rischi interferenti che la Ditta Aggiudicataria, interessata dalla fornitura, introdurrà i seguenti rischi connessi con le "lavorazioni" oggetto dell'appalto:

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	1. Urti o investimenti prodotti da autoveicoli lungo la viabilità interna dei Presidi Ospedalieri e delle altre sedi dell'Azienda. 2. Trasporto di materiali e arredi dall'automezzo all'interno delle sedi oggetto della fornitura.
RISCHIO ELETTRICO	In caso di utilizzo di attrezzature elettriche per l'installazione degli arredi e collaudo attrezzature
POLVERI	Dovuto al montaggio di alcuni arredi.

6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.

Interferenze riscontrate	Indice di Rischio (B, M, A)	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
RISCHIO URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, CADUTA MATERIALE	B	Tutti i percorsi viari interni ai Presidi Ospedalieri e alle altre sedi	<ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio); - non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli; - azionare i segnali visivi di sosta del mezzo durante tutta la fase di carico/scarico.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree esterne all'area di lavoro	Non lasciare materiali o attrezzature incustodite in aree accessibili a personale non addetto ai lavori. Qualora fosse necessario predisporre un'area di deposito, questa deve essere concordata con il RUP/DEC, delimitata e segnalata a cura della Ditta Appaltatrice.
RISCHIO SCIVOLAMENTO E CADUTA	B	Aree di lavoro e zone di passaggio	Prestare attenzione a pavimenti sconnessi che possono presentare fessurazioni e avvallamenti o eventuali gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento di eventuali attrezzature su ruote durante lo spostamento. Evitare di lasciare oggetti e cavi lungo i percorsi e le vie di transito che possono rappresentare rischio di inciampo.
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro	Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo. Concordare con il Servizio Tecnico - Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. Eseguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
POLVERI	B	Aree di lavoro interessate dalla installazione di arredi	Utilizzare avvitatore con aspiratore per la rimozione delle polveri dovuti all'installazione di mensole o altre attrezzature in particolare nelle stanze di degenza.
RUMORE	B	Aree di lavoro interessate dal montaggio di arredi	Utilizzare avvitatore silenziato per il montaggio di arredi al fine di non recare disturbo durante le attività sanitarie e ai pazienti all'interno dei reparti di degenza.
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.
RISCHIO BIOLOGICO	B	Aree di lavoro interne ai reparti di degenza	<ul style="list-style-type: none"> - Concordare preventivamente gli accessi con il Coordinatore del reparto al fine di non interferire con le attività sanitarie; - Attenersi alle specifiche procedure ed indossare, ove indicato, i dispositivi di protezione individuali forniti. - Segnalare tempestivamente eventuali imbrattamenti biologici al personale sanitario per la opportuna sanificazione.

UTILIZZO DI ASCENSORI PER TRASPORTO CARICHI	B	Ascensori interni agli edifici utilizzati per il trasporto materiali e persone	L'utilizzo del montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali: <ul style="list-style-type: none"> • schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati, • cesoiamento, blocco o imprigionamento (in caso di mancanza di energia elettrica o di guasto). Evitare il contemporaneo trasporto di persone. Segnalare tempestivamente al personale di Officina eventuali problemi tecnici, guasti, anomalie di funzionamento per la opportuna manutenzione.
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

(B = basso; M = medio; A = alto)

7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 6 la fornitura in oggetto, comporta rischi da interferenza di basso indice, riconducibili ad un valore accettabile mediante misure di tipo organizzativo e scambio di informazioni tra l'Azienda Ospedaliera AORMN e la Ditta Aggiudicataria.

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

8. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del servizio, da parte della Ditta Aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente con il legale rappresentate o suo delegato e/o il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta Aggiudicataria.

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale. Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I. .

Pesaro, _____

Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Monica Bono
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione





REGIONE MARCHE

Numero 102/AORMNDGEN

Data 09/02/2017

DETERMINA N. 102/AORMNDGEN DEL 09/02/2017

indizione di una procedura aperta per la fornitura di arredo tecnico, arredo sanitario, arredo degenza, carrelli e barelle per le varie UU.OO di questa Azienda.

PUBBLICAZIONE:

dal 09/02/2017 al 23/02/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 09/02/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

09/02/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____