

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -  
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

---

## PROCEDURA NEGOZIATA

**OGGETTO:** 160.10.10/2020/PROV/564 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante MePA di Consip S.p.A., finalizzata alla fornitura di n° 1 Morcellatore.

### VERBALE del 19/02/2021

*(lettura punteggi tecnici ed apertura offerte economiche)*



Visti e richiamati i precedenti verbali;

Visto che comunicato su MePA del 15/02/2021 con il quale, su disposizione del Presidente della Commissione giudicatrice, ha dato comunicazione alle Ditte partecipanti della data lettura dei punteggi tecnici e di di apertura dell'offerta economica

### TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno 19/02/2021 alle ore 13.00 nei locali della UOC Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, Piazzale Cinelli - Padiglione G, si è riunita la Commissione Giudicatrice così composta:

- Dr. Emanuele Cappa - Dirigente Medico della UOC Urologia;
- Inf. Sig.ra Federica Marini - UOC Urologia;
- Ing. Alessandro Cesaroni Ingegnere Biomedico.

è altresì presente la Dott.ssa Daniela Masci, in qualità di RUP della procedura in oggetto.

Si dà lettura del punteggio tecnico complessivo assegnato dalla Commissione giudicatrice (come riportato nel verbale della Commissione allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale – All. n° 1). Successivamente ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, lex specialis della procedura, si procede all'apertura delle offerte economiche ed alla lettura dell'importo complessivo offerto dalle imprese ammesse. Pertanto la Commissione, sulla base della formula esplicitata al punto 14 del disciplinare di gara, procede all'attribuzione dei punteggi economici, alla somma degli stessi con i punteggi tecnici ed alla formazione della seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente	Punteggio Tecnico Totale	Punteggio Economico Totale	OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
MOVI S.P.A	70	27,37	€ 87.297,75	97,37
UROMED SRL	38,2	30	€ 79.652,00	68,2

La commissione riscontra che le offerte economiche presentate rispettano l'importo fissato quale base d'asta.

Il RUP procederà a verificare la presenza di eventuale offerta anomala.

La presente seduta viene sciolta alle ore 14.10.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto.

Dr. Emanuele Cappa

Ing. Federica Marini

Ing. Alessandro Cesaroni

Pesaro, li 19/02/2021

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -  
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**


---

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro  
Tel. 0721/36.6320 - Fax 0721/362470

**PROCEDURA NEGOZIATA**

**OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante MePA di Consip S.p.A., finalizzata alla fornitura di n° 1 Morcellatore.**

**VERBALE  
del 12/02/2021**

Handwritten signatures in black ink, appearing to be two distinct signatures.

Vista e richiamata la determina n. 568 del 05/11/2020 di indizione della procedura per l'affidamento della fornitura di n.1 Morcellatore per la frammentazione e l'aspirazione di tessuti molli dalla vescica completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento;  
richiamata la determina n. 642/DG del 03/12/2020 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice e il Presidente della Commissione come segue:

- **Dr. Emanuele Cappa** – Dirigente Medico della UOC Urologia - presidente;
- **Inf. Federica Marini** – UOC Urologia - componente;
- **Ing. Alessandro Cesaroni** - Ingegnere biomedico della UOC Ingegneria Clinica e ICT - componente;

Il giorno 12/02/2021 presso i locali della UOC Ingegneria Clinica e ICT di Piazzale Cinelli, si riunisce, in seduta riservata e nel plenum dei suoi componenti, la suddetta Commissione giudicatrice al fine di verificare il possesso dei requisiti di minima fissati in capitolato tecnico, pena l'esclusione.

Il Presidente, accertato che la Commissione è presente al completo, alle ore 12:30 dichiara aperta la seduta, accede alla cartella privata dove si trova custodita la documentazione tecnica in formato digitale di ogni partecipante e la rende disponibile per la commissione che procede all'esame della documentazione tecnica presentata dalle imprese partecipanti alla gara in oggetto riscontrando quanto segue:

MOVI SPA	Dall'esame della documentazione tecnica risultano soddisfatti tutti i requisiti di minima richiesti dalla documentazione di gara.
UROMED SRL	Dall'esame della documentazione tecnica risultano soddisfatti tutti i requisiti di minima richiesti dalla documentazione di gara.

A seguire la suddetta commissione giudicatrice prosegue le attività di assegnazione dei punteggi qualitativi relativi alla procedura in oggetto per le ditte rispondenti ai requisiti di minima MOVI SPA e UROMED SRL. La Commissione procede con la lettura collegiale e l'analisi della documentazione tecnica dei concorrenti e, successivamente, con l'attribuzione dei punteggi qualitativi secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico. Ciascun commissario provvede alla compilazione manuale delle tabelle cartacee assegnate, per ogni singolo parametro di valutazione.

Al termine, le tabelle vengono riprodotte in un unico foglio excel. Ciascun commissario verifica la corrispondenza tra la compilazione manuale e quella elettronica e approva quest'ultima sottoscrivendone la stampa. Tali fogli stampati e sottoscritti vengono allegati al presente verbale (Allegato1) quale sua parte integrante e sostanziale.


La Commissione procede, tramite foglio excel, al calcolo dei valori medi dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario su ogni singolo criterio ed alla loro riparametrazione, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La Commissione elabora la tabella delle medie dei coefficienti, delle medie riparametrate e, tramite prodotto con i pesi per ciascun criterio, procede al computo dei punteggi complessivi di cui alla griglia di attribuzione dei punteggi qualitativi.

La Commissione procede quindi alla compilazione del prospetto definitivo (Allegato1) della valutazione delle offerte tecniche contenente il punteggio tecnico provvisorio e riparametrato.

La seduta viene sciolta alle ore 14:15.

Del che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma viene sottoscritto. La documentazione tecnica rimane archiviata in cartella privata.

**Dr. Emanuele Cappa**

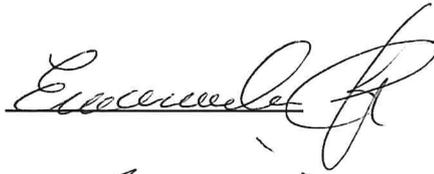Handwritten signature of Emanuele Cappa in black ink, written over a horizontal line.


**Inf. Federica Marini**

Handwritten signature of Federica Marini in black ink, written over a horizontal line.

**Ing. Alessandro Cesaroni**

Handwritten signature of Alessandro Cesaroni in black ink, written over a horizontal line.

Pesaro, li 12/02/2021



*Dee*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE MARCHE -  
AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"


---

Sede Legale: P.le Cinelli – 6121 Pesaro  
Tel. 0721/366320 - Fax 0721/362470

**PROCEDURA NEGOZIATA**

**OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante MePA di Consip S.p.A., finalizzata alla fornitura di n° 1 Morcellatore.**

1  Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom of the page.



Joe de B

**ALLEGATO 1****DITTE OFFERENTI E PRODOTTI OFFERTI**

<b>Fornitore</b>	<b>Produttore</b>	<b>Esclusione</b>
<b>MOVI SPA</b>	Richard Wolf	NO
<b>UROMED SRL</b>	Karl Storz SE & CO	NO

**VALUTAZIONE TECNICA**

**Le offerte tecniche presentate dalle ditte MOVI SPA e UROMED SRL soddisfano i requisiti di minima richiesti in capitolato. Tutti i parametri costruttivi dichiarati in questionario tecnico dalle ditte sono stati verificati nei rispettivi manuali d'uso allegati alla documentazione di offerta. Qualora i dati dichiarati in questionario tecnico siano discordanti con quelli indicati nel manuale d'uso, la commissione all'unanimità ha ritenuto opportuno prendere in considerazione come validi i valori dichiarati nei rispettivi manuali d'uso.**

**A – Caratteristiche tecniche del morcellatore – Punti max. 14,0**

Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa tutte le caratteristiche preferenziali richieste. In particolare si apprezzano le caratteristiche relative alla CP3 legate alla velocità della lama. Si apprezzano inoltre l'interfaccia e la visualizzazione dei parametri per semplicità e funzionalità. Appreziate le caratteristiche tecniche costruttive del generatore e l'impostazione dei parametri e delle funzionalità relative all'arresto della lama rotante.

Ditta UROMED SRL: Il prodotto offerto non soddisfa la CP3: velocità della lama compresa tra 500 e 5000 giri/min. Buone le caratteristiche tecniche generali del morcellatore. Apprezzata l'interfaccia e alla visualizzazione dei parametri e le impostazioni.

**B – Caratteristiche tecniche della pompa – Punti max. 14,0**

Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa tutte le caratteristiche preferenziali richieste. In particolare sono apprezzate le impostazioni programmabili e attivabili da pedale. Inoltre apprezzata la modalità di generazione del vuoto.

Ditta UROMED SRL: La ditta offerente soddisfa tutte le caratteristiche preferenziali richieste. Apprezzata la potenza di aspirazione e le caratteristiche tecniche costruttive generali della pompa.

**C – Caratteristiche tecniche/funzionali manipoli e frese – Punti max. 12,0**

Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa tutte le caratteristiche preferenziali richieste. Particolarmente apprezzate le caratteristiche tecniche/funzionali di manipoli e frese. In particolare molto apprezzate le tipologie di frese offerte, sia monouso che poliuso, caratterizzate da due componenti: una camicia esterna con estremità smussa e arrotondata completamente atraumatica dotata di un'ampia fenestratura con geometria a goccia, e una fresa interna dotata di bordi zigrinati che rappresenta la lama attiva per la morcellazione vera e propria. La fenestratura della camicia esterna è collocata solo sulla porzione superiore evitando in tal modo di morcellare parti di tessuto prostatico indesiderate. Tali caratteristiche sono particolarmente apprezzate soprattutto da un punto di vista operativo per i vantaggi clinici legati alla atraumaticità della punta della fresa.

Ditta UROMED SRL: Il prodotto offerto non soddisfa la CP13. Meno apprezzate le caratteristiche tecniche/costruttive di camice e tipologia di frese.

**D – Kit di morcellazione/enucleazione – Punti max. 10,0**

Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa la caratteristica preferenziale richiesta.

Ditta UROMED SRL: Il prodotto offerto non soddisfa la caratteristica preferenziale richiesta.

**E – Sicurezza – Punti max. 10,0**

Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa le caratteristiche preferenziali richieste. Particolarmente apprezzato, da un punto di vista di sicurezza operativa, il sistema di gestione distinto di morcellazione e di aspirazione tramite doppio pedale.

Ditta UROMED SRL: Il prodotto offerto soddisfa le caratteristiche preferenziali richieste. Il pedale presenta una funzione a due livelli: premendo il pedale fino a raggiungere il punto di pressione (3/4 dalla corsa del pedale) viene attivata soltanto la pompa. Se si supera il punto di pressione (nell'ultimo quarto di corsa del pedale), viene attivata la funzione shaver oltre alla pompa di aspirazione.

**F – Display di controllo del morcellatore e della pompa – Punti max. 10,0**


Ditta MOVI SPA: Il prodotto offerto soddisfa la caratteristica preferenziale richiesta.

Ditta UROMED SRL: Il prodotto offerto soddisfa solo parzialmente la caratteristica preferenziale richiesta. E' soddisfatta solamente per l'unità morcellatore.

**Dr. Emanuele Cappa**

Handwritten signature of Emanuele Cappa in black ink, written over a horizontal line.

**Inf. Federica Marini**

Handwritten signature of Federica Marini in black ink, written over a horizontal line.

**Ing. Alessandro Cesaroni**


Handwritten signature of Alessandro Cesaroni in black ink, written over a horizontal line.

## COMMISSARIO 1

Criteri	Descrizione	COEFFICIENTI	
		MOVI SPA	UROMED SRL
A	Caratteristiche tecniche del morcellatore	1	0,75
B	Caratteristiche tecniche della pompa	1	0,75
C	Caratteristiche tecniche/funzionali manipoli e frese	1	0,50
D	Kit di morcellazione/enucleazione	1	0
E	Sicurezza	1	0,50
F	Display di controllo del morcellatore e della pompa	1	0,50

Dr. Emanuele Cappa






*R. Lee K.*

## COMMISSARIO 2

Criteri	Descrizione	COEFFICIENTI	
		MOVI SPA	UROMED SRL
A	Caratteristiche tecniche del morcellatore	1	0,75
B	Caratteristiche tecniche della pompa	1	0,75
C	Caratteristiche tecniche/funzionali manipoli e frese	1	0,65
D	Kit di morcellazione/enucleazione	1	0
E	Sicurezza	1	0,50
F	Display di controllo del morcellatore e della pompa	1	0,50

Inf. Federica Marini






*R. J. M.*

## COMMISSARIO 3

Criteri	Descrizione	COEFFICIENTI	
		MOVI SPA	UROMED SRL
A	Caratteristiche tecniche del morcellatore	1	0,75
B	Caratteristiche tecniche della pompa	1	0,75
C	Caratteristiche tecniche/funzionali manipoli e frese	1	0,65
D	Kit di morcellazione/enucleazione	1	0
E	Sicurezza	1	0,50
F	Display di controllo del morcellatore e della pompa	1	0,50

Ing. Alessandro Cesaroni






See the 

## COMPLESSIVO

Criteri	Descrizione	Peso	DITTA MOVI SPA		DITTA UROMED SRL	
			Media coefficienti	PUNTEGGI	Media coefficienti	PUNTEGGI
A	Caratteristiche tecniche del morcellatore	14	1	14	0,75	10,50
B	Caratteristiche tecniche della pompa	14	1	14	0,75	10,50
C	Caratteristiche tecniche/funzionali manipoli e frese	12	1	12	0,60	7,20
D	Kit di morcellazione/enucleazione	10	1	10	0	0
E	Sicurezza	10	1	10	0,50	5,00
F	Display di controllo del morcellatore e della pompa	10	1	10	0,50	5,00
<b>TOTALE PUNTEGGIO (PTP)</b>		<b>70</b>		<b>70,00</b>		<b>38,20</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO (PTR)</b>				<b>70,00</b>		<b>38,20</b>

Dr. Emanuele Cappa




Inf. Federica Marini



Ing. Alessandro Cesaroni





Joseph A.